

# INTEGRA™ BRAIN MAPPING

PRODUKTAKTALOG

*Innovationen. Für das Leben.*



 INTEGRA™



BRAIN  
MAPPING

# Bestell- und Gewährleistungsinformationen

## Preisgestaltung:

Die in spezifischen schriftlichen Angeboten genannten Preise verstehen sich fest und unveränderlich für einen im Angebot definierten Zeitraum und unterliegen ansonsten Änderungen mit vorheriger Benachrichtigung.

## Mindestauftragsvolumen:

Das Mindestauftragsvolumen beträgt 250 € (für jeden Auftrag unter 250 € wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20 € erhoben).

## Auftragsverfahren:

Bestellungen von Integra LifeScience Produkten bedürfen der Schriftform.

## Auftragsannahme:

Die Aufträge werden per Genehmigung durch den Customer Service angenommen.

## Rücksendeverfahren:

- Vor jeder Rücksendung eines Produkts ist die Einwilligung des Kundendienstes einzuholen. Nach Genehmigung kann die Ware unter Angabe der von uns erteilten Rücksendenummer zurückgesandt werden.
- Sterile Produkte sind in ungeöffneten, unbeschädigten Kartons zurückzusenden, deren Verpackung Schäden verhindert.
- Nicht sterile Produkte sind in ungebrauchten, versiegelten Originalverpackungen zurückzusenden.
- Für speziell angepasste Produkte oder Produkte aus Sonderanfertigungen wird keine Gutschrift erteilt.
- Gutschriften werden für Waren ausgestellt, die innerhalb von neunzig Tagen ab dem Versanddatum zurückgeschickt werden, und zwar abzüglich einer 20 %igen Rücknahmegebühr, bzw. 50 %igen Rücknahmegebühr nach 3-6 Monaten. Nach mehr als 6 Monaten kann für Waren keine Gutschrift mehr erteilt werden. Voraussetzung ist, dass das zurückgesandte Produkt unbeschädigt ist und nachweislich weder benutzt noch geöffnet worden ist.

## Begrenzte Gewährleistung von Integra

Die INTEGRA LIFESCIENCES CORPORATION und ihre hundertprozentigen Tochtergesellschaften («INTEGRA») garantieren autorisierten INTEGRA-Vertriebspartnern und dem Originalkäufer nur, dass jedes neue INTEGRA-Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Wartung zwei (2) Jahre (sofern bei Zubehörteilen nicht ausdrücklich anders angegeben) ab dem Datum der Auslieferung von INTEGRA (oder ihrem autorisierten Vertriebspartner) an den Originalkäufer, keinesfalls jedoch über das auf dem Produktetikett angegebene Verfallsdatum hinaus, frei von Material- oder Herstellungsfehlern ist. Bei Produkten, die von INTEGRA durch einen autorisierten INTEGRA-Vertriebspartner verkauft werden, bezieht sich «Originalkäufer» auf den Käufer von INTEGRA-Produkten, an den der Vertriebspartner das Produkt als erstes verkauft hat.

Es wird garantiert, dass chirurgische Instrumente frei von Material- und Herstellungsfehlern sind, wenn sie ordnungsgemäß gepflegt und gereinigt und normalerweise für den vorgesehenen Verwendungszweck verwendet werden.

Jedes gedeckte Produkt, das von INTEGRA unter einen Pacht-, Miet- oder Mietkaufvertrag gestellt wurde und das während der Dauer der Vertrages repariert werden muss, wird gemäß den jeweiligen Vertragsbestimmungen repariert.

Wenn während der Gewährleistungsfrist oder der Dauer eines solchen Vertrages ein dadurch abgedeckter Mangel auftritt, sollte sich der Käufer oder Vertriebspartner direkt mit INTEGRA in Verbindung setzen. Wenn der Käufer oder Vertriebspartner sich auf die Bestimmungen dieser Gewährleistung berufen möchte, muss das Produkt an INTEGRA zurückgesendet werden. Das defekte Produkt sollte umgehend eingesendet, ordnungsgemäß verpackt und das Porto im Voraus bezahlt werden. Verluste oder Beschädigungen bei der Rücksendung an INTEGRA erfolgen auf Gefahr des Versenders. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Gewährleistung und geltender Vereinbarungen besteht INTEGRAS alleinige Verantwortung im Rahmen dieser Gewährleistung in der Reparatur oder im Ersatz nach INTEGRAS eigenem Ermessen und auf INTEGRAS Kosten.

AUF KEINEN FALL HAFTET INTEGRA FÜR ZUFÄLLIGE SCHÄDEN, MITTELBARE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER STRAFSCHADENSERSATZ IN VERBINDUNG MIT DEM ERWERB ODER DER NUTZUNG VON INTEGRA-PRODUKTEN. Ferner gilt diese Gewährleistung nicht und INTEGRA trägt dem Kunden gegenüber nicht die Verantwortung für jeglichen Verlust, der in Verbindung mit dem Kauf oder der Nutzung eines INTEGRA-Produkts entsteht, das von einer anderen Person als einem autorisierten Servicepartner von INTEGRA repariert oder INTEGRAS Auffassung nach so verändert wurde, dass sich dies auf seine Stabilität oder Zuverlässigkeit auswirkt, oder welches einer missbräuchlichen Verwendung, Nachlässigkeit oder einem Unfall ausgesetzt wurde oder welches nicht entsprechend der von INTEGRA bereitgestellten Gebrauchsanweisung verwendet wurde.

DIESE BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG VON INTEGRA IST AUSSCHLIESSLICHER ART UND GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN

## Kontaktinformationen Customer Service

### International

+33 (0)4 37 47 59 50  
+33 (0)4 37 47 59 25 (Fax)  
csemea@Integra-LS.com

### Benelux

+32 (0)2 257 4130  
+32 (0)2 253 2466 (Fax)  
custsvbenelux@Integra-LS.com

### Frankreich

+33 (0) 4 37 47 59 10  
+33 (0) 4 37 47 59 29 (Fax)  
custsvcfrance@Integra-LS.com

### Großbritannien/Nordirland

+44 (0) 1264 345 780  
+44 (0) 1264 363 782 (Fax)  
custsvcuk@Integra-LS.com

### Deutschland

+49 (0) 2102 5535 6200  
+49 (0) 2102 5536 636 (Fax)  
custsvcgermany@Integra-LS.com

### Schweiz

+41 (0) 2 27 21 23 30  
+41 (0) 2 27 21 23 99 (Fax)  
custsvcsuisse@Integra-LS.com

GEWÄHRLEISTUNGEN UND ANSTELLE ALLER ANDEREN VERPFLICHTUNGEN ODER VERBINDLICHKEITEN SEITENS INTEGRA ODER SEITENS IHRER VERTRIEBSPARTNER. INTEGRA ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG ANDERER ART IN VERBINDUNG MIT INTEGRAS PRODUKTEN, NOCH ERMÄCHTIGT INTEGRA EINEN VERTRETER ODER EINE Dritte PERSON, EINE SOLCHE HAFTUNG FÜR INTEGRA ZU ÜBERNEHMEN.

INTEGRA LEHNT ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMten ZWECK ODER EINE BESTIMMTE ANWENDUNG ODER DER EIGENSCHAFTZUSICHERUNG SOWIE JEGLICHER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR PATIENTEN, AB. Weder kann eine Handlung oder Erklärung eine Gewährleistung oder Garantie darstellen, noch kann diese Standardgewährleistung auf irgendeine Weise geändert werden, außer durch ein von einer Führungskraft von INTEGRA unterzeichnetes Schriftstück. Diese Beschränkungen hinsichtlich der Erstellung oder Änderung dieser Gewährleistung können weder mündlich noch durch irgendeine Handlungsweise abgedungen werden.

AUF KEINEN FALL HAFTEN AUTORISIERTE INTEGRA-VERTRIEBSPARTNER GEGENÜBER DEM ORIGINALKÄUFER FÜR ZUFÄLLIGE SCHÄDEN, MITTELBARE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER STRAFSCHADENSERSATZ IN VERBINDUNG MIT DEM ERWERB ODER DER NUTZUNG VON INTEGRA-PRODUKTEN. Ferner gilt diese Gewährleistung nicht und autorisierte INTEGRA-Vertriebspartner tragen dem Originalkäufer gegenüber nicht die Verantwortung für jeglichen Verlust, der in Verbindung mit dem Kauf oder der Nutzung eines INTEGRA-Produkts entsteht, das von einer anderen Person als einem autorisierten Servicepartner von INTEGRA repariert oder so verändert wurde, dass sich dies auf seine Stabilität oder Zuverlässigkeit auswirkt, oder welches einer missbräuchlichen Verwendung, Nachlässigkeit oder einem Unfall ausgesetzt wurde oder welches nicht entsprechend der von INTEGRA bereitgestellten Gebrauchsanweisung verwendet wurde. DIESE FÜR INTEGRA-VERTRIEBSHÄNDLER BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG IST AUSSCHLIESSLICHER ART UND GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN GEGENÜBER DEM ORIGINALKÄUFER UND ANSTELLE ALLER ANDEREN VERPFLICHTUNGEN ODER VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DEM ORIGINALKÄUFER SEITENS AUTORIZIERTER INTEGRA-VERTRIEBSPARTNER.

AUTORISIERTE INTEGRA-VERTRIEBSPARTNER LEHNEN ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN GEGENÜBER DEM ORIGINALKUNDEN AB, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMten ZWECK ODER EINE BESTIMMTE ANWENDUNG ODER DER ZUSICHERUNG EINER EIGENSCHAFT SOWIE JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR PATIENTEN.

<b>Streifenelektroden .....</b>	<b>1</b>
Kortikale Streifenelektrode mit zylindrischem Konnektor .....	1-2
Doppelseitige kortikale Streifenelektrode mit zylindrischem Konnektor .....	3
<b>Gitterelektroden .....</b>	<b>4</b>
Kortikale Gitterelektrode mit zylindrischem Konnektor .....	4-7
3D-konformes Gitter 8x8 .....	7
Gekrümmte Gitterelektrode mit zylindrischem Konnektor .....	8
Gekrümmte doppelseitige Gitterelektrode mit zylindrischem Konnektor.....	9-10
<b>Epidurale Peg-Elektroden .....</b>	<b>11</b>
<b>Sphenoidalelektroden .....</b>	<b>12</b>
<b>Elektroden-Anschlusskabel .....</b>	<b>13</b>
CamLock-Anschlusssystem .....	13
Mikro-Anschlusskabel .....	13
<b>Ojemann-Kortexstimulator .....</b>	<b>14</b>
Stichwortverzeichnis .....	15

# Streifenelektroden




## Auragen™ kortikale Streifenelektrode mit zylindrischem Konnektor

Auragen™ kortikale Streifenelektroden sind extra dünn und flexibel, um die intrakranielle Platzierung durch ein Bohrloch zu erleichtern. Der schmale zylindrische Konnektor vereinfacht die Tunnelung mit einer 14G-Tunnelingnadel und ermöglicht den schnellen und sicheren Anschluss an das patentierte Konnektor-System. Sie sind mit Auragen™ Kontakten erhältlich. Für maximalen Kontakt mit dem Kortex sind die Kontakte mit Vertiefungen versehen.


### Elektrode mit 2 Kontakten

Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU1X2P	AURAGEN™ MIT 2 KONTAKTEN KABEL: ECCFS02  Farbkodierung zur besseren Identifikation

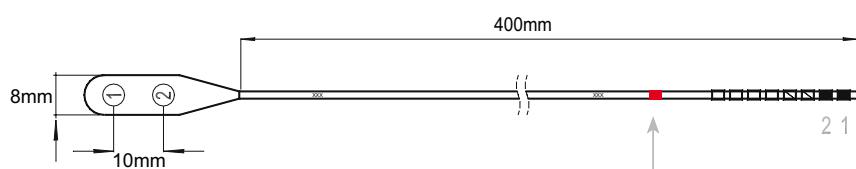


### Elektrode mit 4 Kontakten

Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU1X4P	AURAGEN™ MIT 4 KONTAKTEN KABEL: ECCFS04

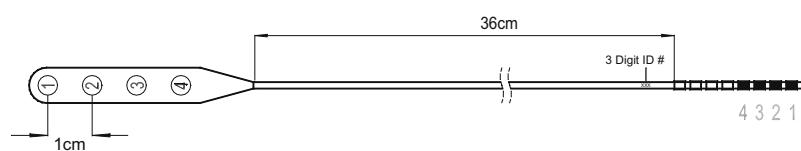


### Elektrode mit 6 Kontakten


Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU1X6P	AURAGEN™ MIT 6 KONTAKTEN KABEL: ECCFS06

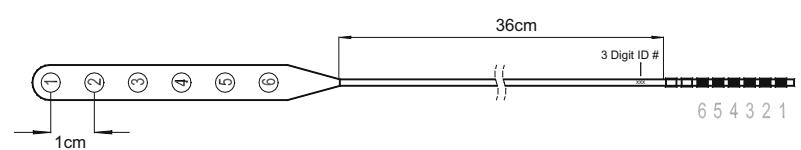

### Elektrode mit 6 Kontakten • Kontaktabstand 7,5 mm


Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU1X6PM75	AURAGEN™ MIT 6 KONTAKTEN KABEL: ECCFS06

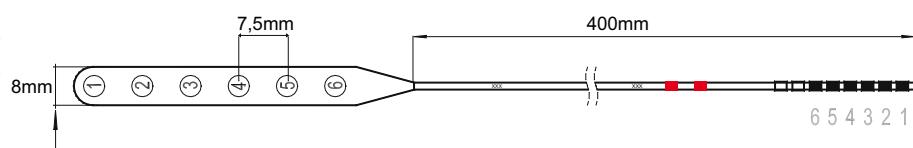

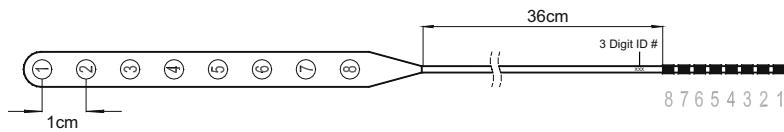

Elektrode mit 8 Kontakten


Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU1X8P	AURAGEN™ MIT 8 KONTAKTEN KABEL: ECCFS08

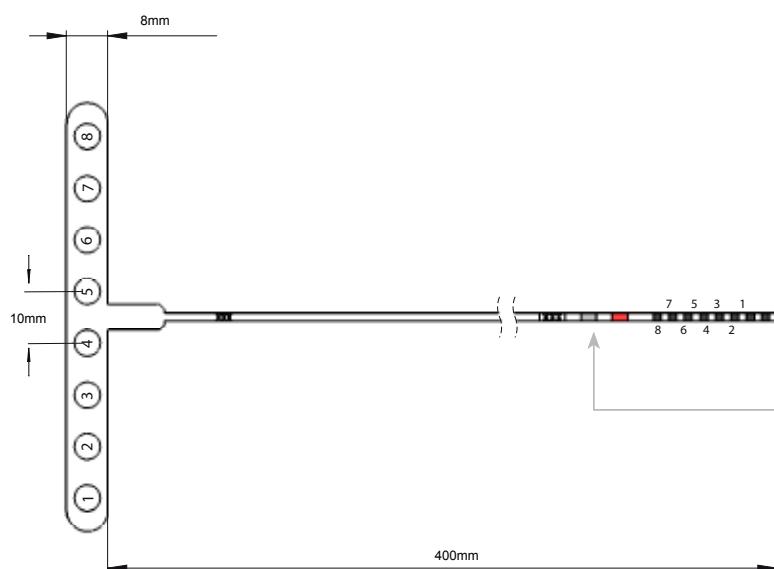

Elektrode mit 8 Kontakten


Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU8X1P	AURAGEN™ MIT 8 KONTAKTEN KABEL: ECCFS08

Farbkodierung zur besseren Identifikation

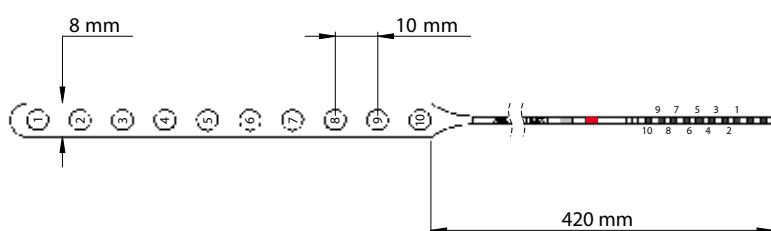

Elektrode mit 10 Kontakten

Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU1X10P	AURAGEN™ MIT 10 KONTAKTEN KABEL: ECCFS10

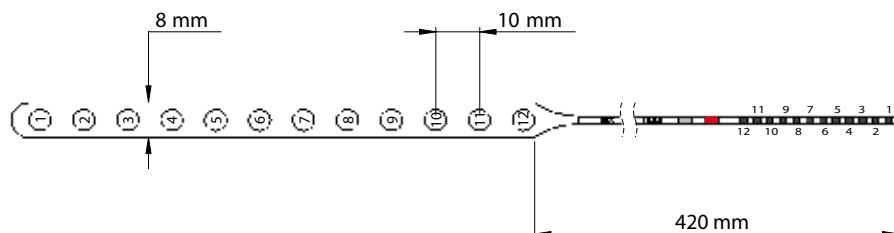

Elektrode mit 12 Kontakten


Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU1X12P	AURAGEN™ MIT 12 KONTAKTEN KABEL: ECCFS12

# Streifenelektroden

## Auragen™ doppelseitige kortikale Streifenelektrode mit zylindrischem Konnektor

### Elektrode mit 8 Kontakten


Katalog-Nr.	Spezifikationen
<b>AU1X4PD</b>	AURAGEN™ MIT 8 KONTAKTEN KABEL: ECCFS08

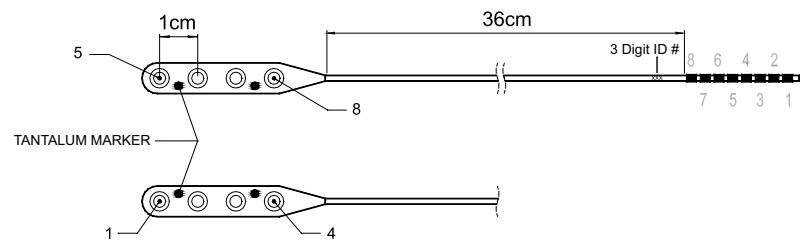

Die Kontakte sind mit der Oberseite nach oben abgebildet

### Elektrode mit 12 Kontakten


Katalog-Nr.	Spezifikationen
<b>AU1X6PD</b>	AURAGEN™ MIT 12 KONTAKTEN KABEL: ECCFS12

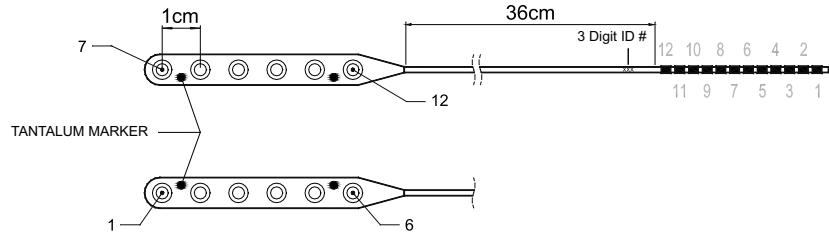

Die Kontakte sind mit der Oberseite nach oben abgebildet

### Elektrode mit 16 Kontakten

Katalog-Nr.	Spezifikationen
<b>AU1X8PD2</b>	AURAGEN™ MIT 16 KONTAKTEN KABEL: ECCFS16

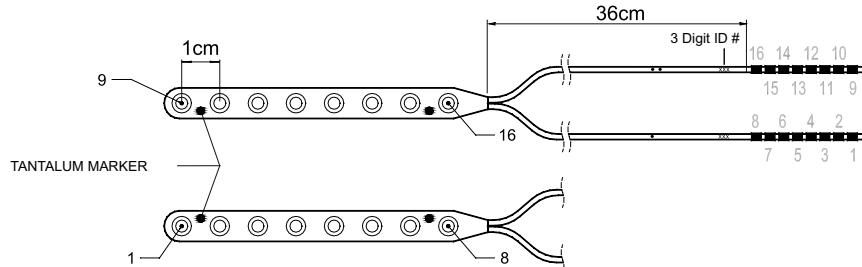


Die Kontakte sind mit der Oberseite nach oben abgebildet

## Auragen™ kortikale Gitterelektrode mit zylindrischem Konnektor




Auragen™ Gitterelektroden sind dünn und flexibel, damit sie leichter platziert werden können und sich an die Krümmung der Kortexoberfläche anpassen. Der schmale zylindrische Konnektor vereinfacht die Tunnelung mit einer 14G-Tunnelingnadel und ermöglicht den schnellen und sicheren Anschluss an das patentierte Konnektor-System. Sie sind mit Auragen™ Kontakten erhältlich. Für maximalen Kontakt mit dem Kortex sind die Kontakte mit Vertiefungen versehen.

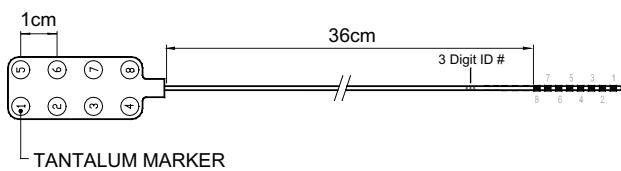

### Elektrode mit 8 Kontakten

Katalog-Nr. | Spezifikationen


**AU2X4P1** AURAGEN™ MIT 8 KONTAKTEN  
KABEL: ECCFS08

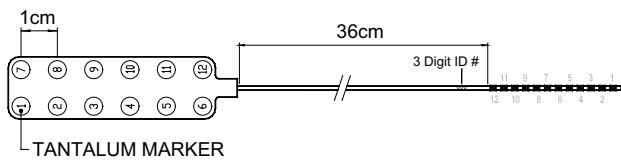

### Elektrode mit 12 Kontakten

Katalog-Nr. | Spezifikationen

**AU2X6P1** AURAGEN™ MIT 12 KONTAKTEN  
KABEL: ECCFS12

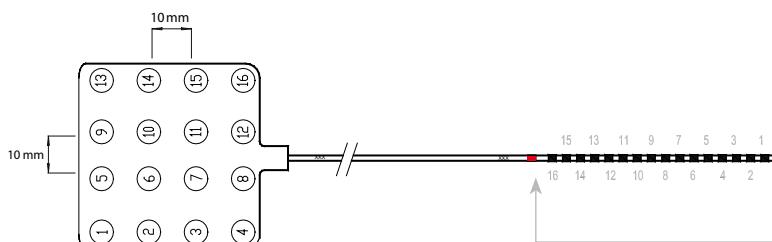


### Elektrode mit 16 Kontakten

Katalog-Nr. | Spezifikationen

**AU4X4P1** AURAGEN™ MIT 16 KONTAKTEN  
KABEL: ECCFS16


Farbkodierung zur besseren Identifikation

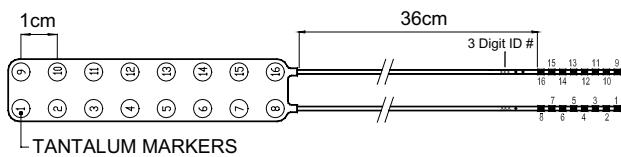

### Elektrode mit 16 Kontakten

Katalog-Nr. | Spezifikationen

**AU2X8P2** AURAGEN™ MIT 16 KONTAKTEN  
KABEL: ECCFS16

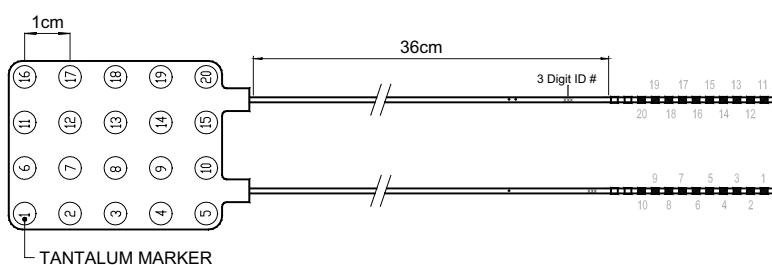

### Elektrode mit 20 Kontakten

Katalog-Nr. | Spezifikationen

**AU4X5P2** AURAGEN™ MIT 20 KONTAKTEN  
KABEL: ECCFS20


# Gitterelektroden

## Auragen™ kortikale Gitterelektrode mit zylindrischem Konnektor (Fortsetzung)

### Elektrode mit 20 Kontakten


Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU4X5P12	AURAGEN™ MIT 20 KONTAKTEN KABEL: ECCFS20

Farbkodierung zur besseren Identifikation

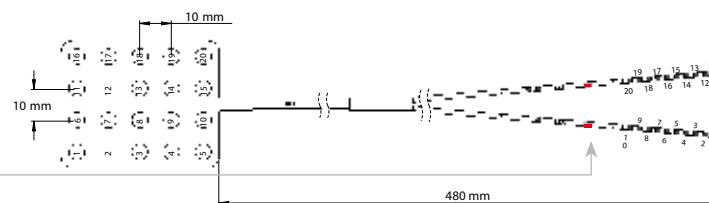


### Elektrode mit 24 Kontakten

Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU4X6P2	AURAGEN™ MIT 24 KONTAKTEN KABEL: ECCFS24

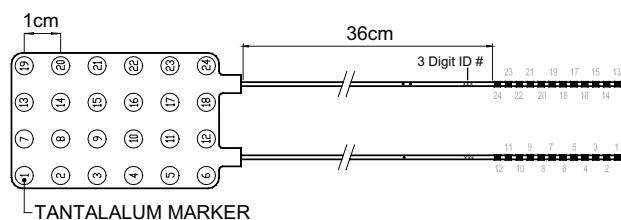


### Elektrode mit 32 Kontakten

Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU4X8P4	AURAGEN™ MIT 32 KONTAKTEN KABEL: ECCFS32

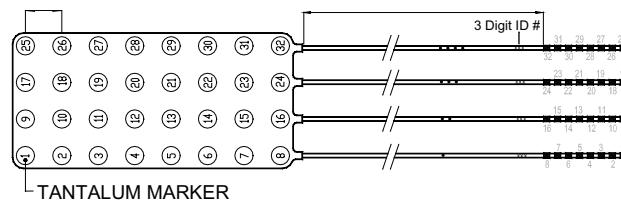


### Elektrode mit 40 Kontakten

Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU5X8P15	AURAGEN™ MIT 40 KONTAKTEN KABEL: ECCFS48

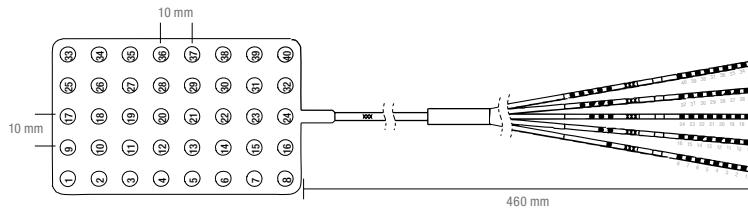


### Elektrode mit 48 Kontakten

Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU6X8P6	AURAGEN™ MIT 64 KONTAKTEN KABEL: ECCFS48

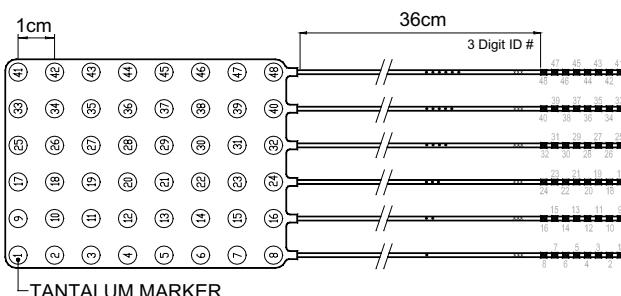


### Elektrode mit 64 Kontakten

Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU8X8P8	AURAGEN™ MIT 64 KONTAKTEN KABEL: ECCFS64

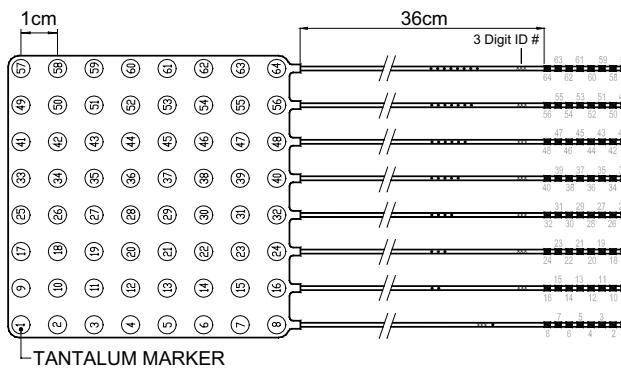


## Auragen™ kortikale Gitterelektrode mit zylindrischem Konnektor (Fortsetzung)

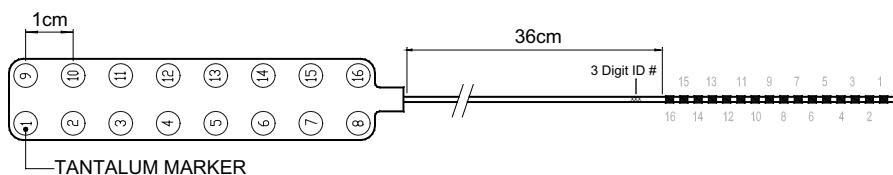


### Elektrode mit 16 Kontakten

Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU2X8P1	AURAGEN™ MIT 16 KONTAKTEN KABEL: 17185C16

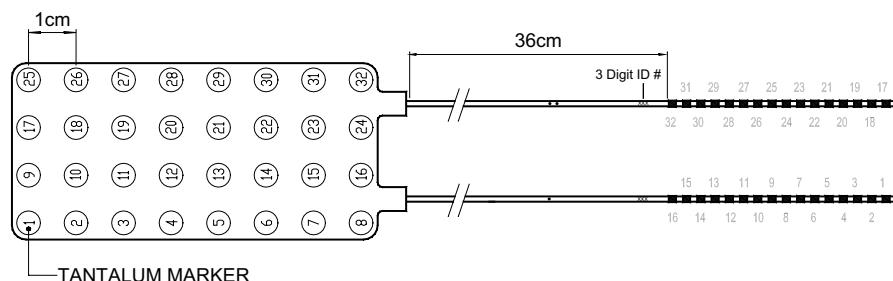

### Elektrode mit 32 Kontakten


Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU4X8P2	AURAGEN™ MIT 32 KONTAKTEN KABEL: 17185C32

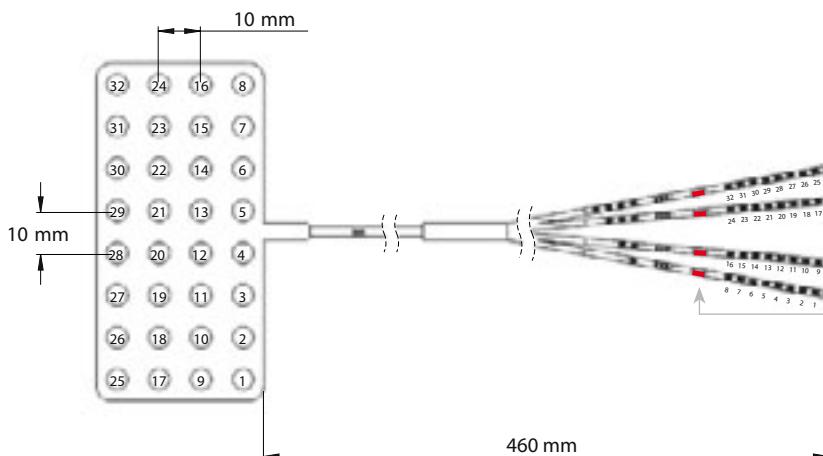

### Elektrode mit 32 Kontakten

Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU8X4P14	AURAGEN™ MIT 32 KONTAKTEN KABEL: ECCFS32

Farbkodierung zur besseren Identifikation

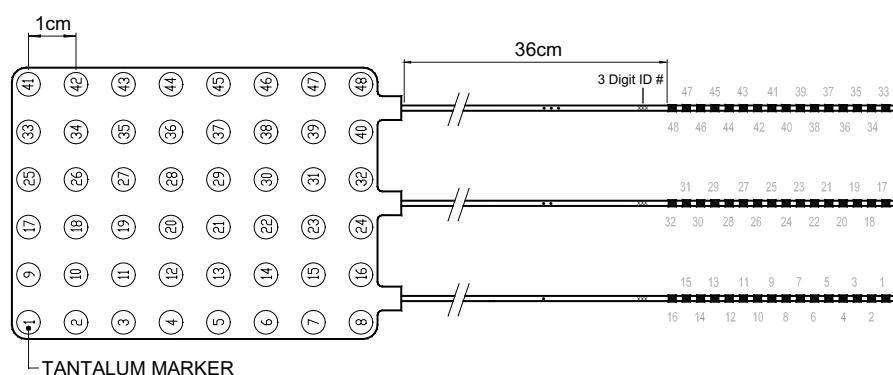

### Elektrode mit 48 Kontakten


Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU6X8P3	AURAGEN™ MIT 48 KONTAKTEN KABEL: 17185C48

# Gitterelektroden

## Auragen™ kortikale Gitterelektrode mit zylindrischem Konnektor (Fortsetzung)


### Elektrode mit 64 Kontakten

Katalog-Nr.	Spezifikationen
<b>AU8X8P4</b>	AURAGEN™ MIT 64 KONTAKTEN KABEL: 17185C64

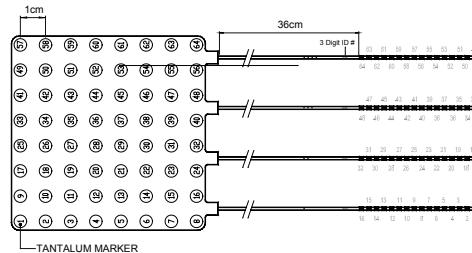


### Elektrode mit 64 Kontakten • Kontaktabstand 4 mm

Katalog-Nr.	Spezifikationen
<b>AU8X8P4M4</b>	AURAGEN™ MIT 64 KONTAKTEN KABEL: 17185C64

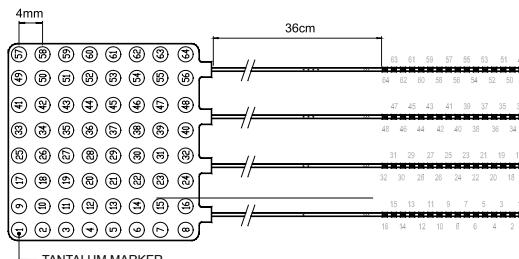


### Elektrode mit 64 Kontakten • Kontaktabstand 7,5 mm

Katalog-Nr.	Spezifikationen
<b>AU8X8P4M75</b>	AURAGEN™ MIT 64 KONTAKTEN KABEL: 17185C64

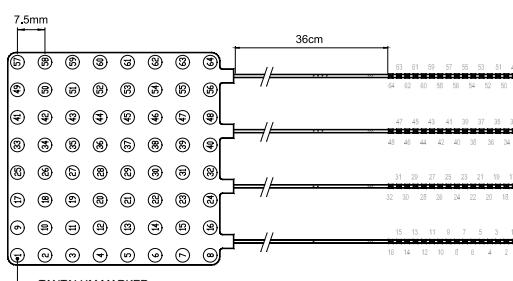

### Elektrode mit 64 Kontakten


Katalog-Nr.	Spezifikationen
<b>AU8X8P4V</b>	AURAGEN™ MIT 64 KONTAKTEN KABEL: 17185C64

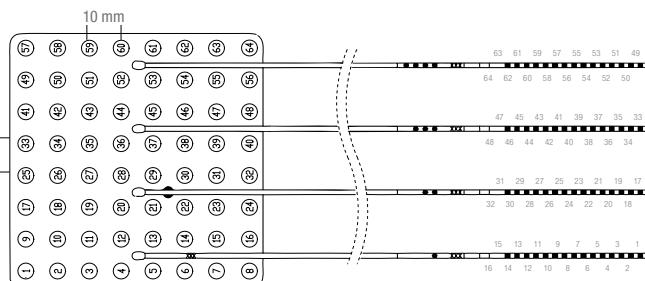

### 3D-konformes Gitter 8x8

#### Elektrode mit 64 Kontakten


Katalog-Nr.	Spezifikationen
<b>AU8X8P14S</b>	AURAGEN™ MIT 64 KONTAKTEN KABEL: 17185C64

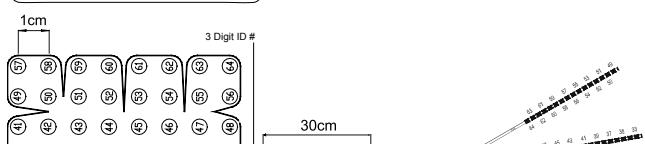


### 3D-konformes Gitter 8x8

#### Elektrode mit 64 Kontakten

Katalog-Nr.	Spezifikationen
<b>AU8X8P4S</b>	AURAGEN™ MIT 64 KONTAKTEN KABEL: 17185C64

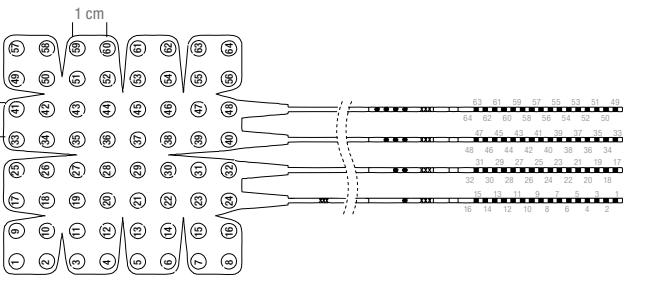


## Auragen™ gekrümmte Gitterelektrode mit zylindrischem Konnektor

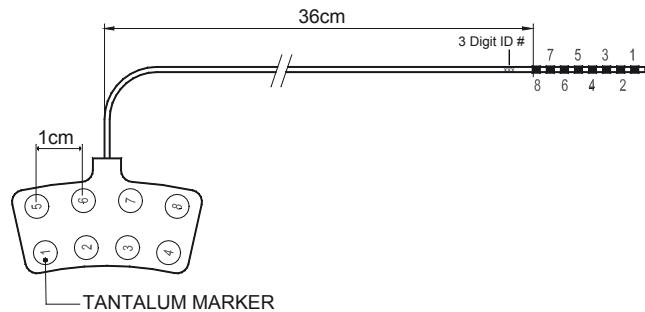


### Elektrode mit 8 Kontakten

Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU4X2P1C	AURAGEN™ MIT 8 KONTAKTEN KABEL: ECCFS08

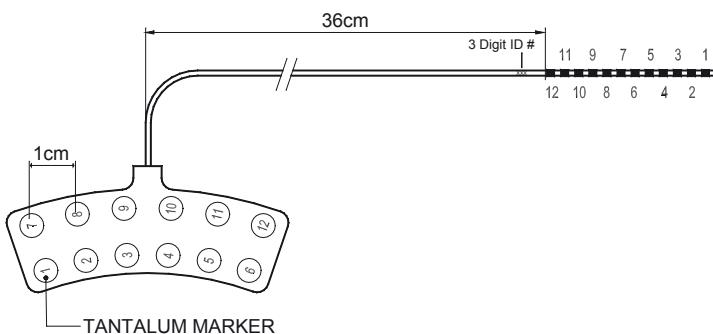

### Elektrode mit 12 Kontakten

Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU6X2P1C	AURAGEN™ MIT 12 KONTAKTEN KABEL: ECCFS12

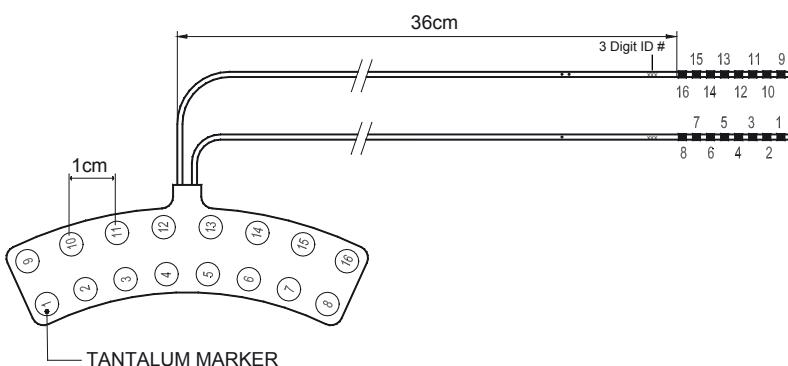

### Elektrode mit 16 Kontakten


Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU8X2P2C	AURAGEN™ MIT 16 KONTAKTEN KABEL: ECCFS16

# Gitterelektroden

## Auragen™ gekrümmte doppelseitige Gitterelektrode mit zylindrischem Konnektor

### Elektrode mit 16 Kontakten


Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU4X2P2CD	AURAGEN™ MIT 16 KONTAKTEN KABEL: ECCFS16

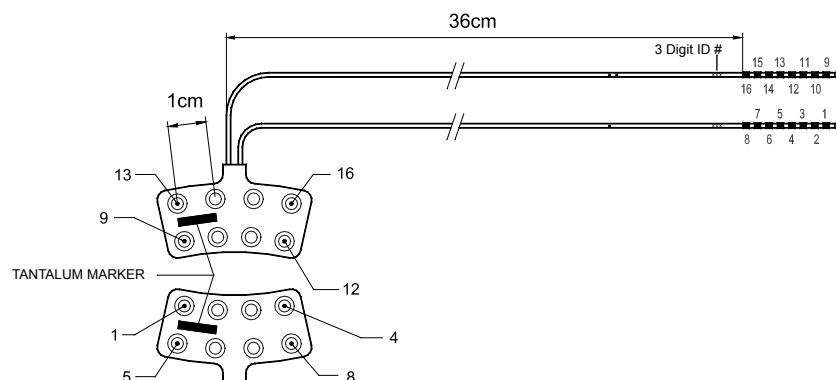

Die Kontakte sind mit der Oberseite nach oben abgebildet


### Elektrode mit 24 Kontakten

Katalog-Nr.	Spezifikationen
AU6X2P2CD	AURAGEN™ MIT 24 KONTAKTEN KABEL: ECCFS24

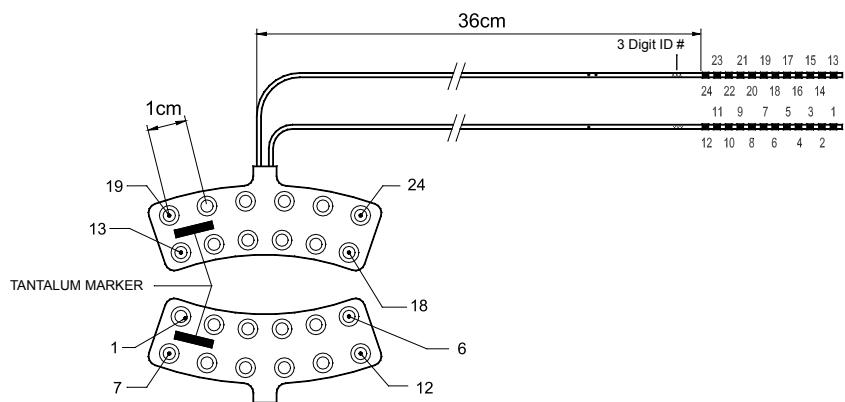

Die Kontakte sind mit der Oberseite nach oben abgebildet


## Auragen™ gekrümmte doppelseitige Gitterelektrode mit zylindrischem Konnektor (Fortsetzung)

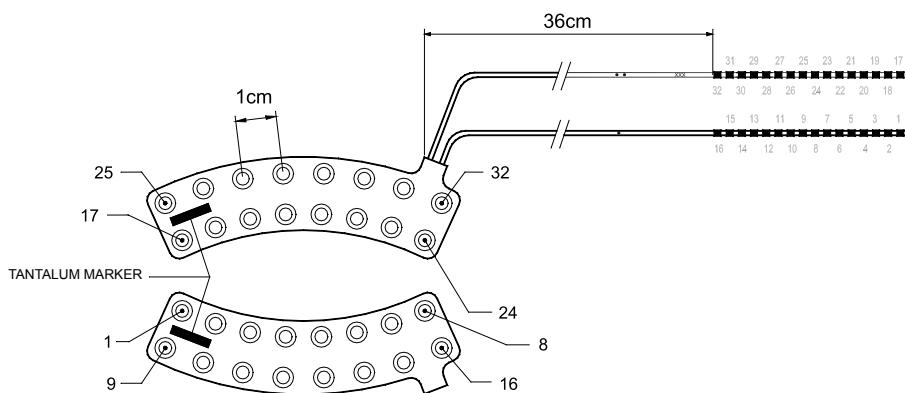

**Elektrode mit 32 Kontakten**

Katalog-Nr.	Spezifikationen
<b>AU8X2P2CDL</b>	AURAGEN™ MIT 32 KONTAKTEN CABLE : 17185C32

Die Kontakte sind mit der Oberseite nach oben abgebildet

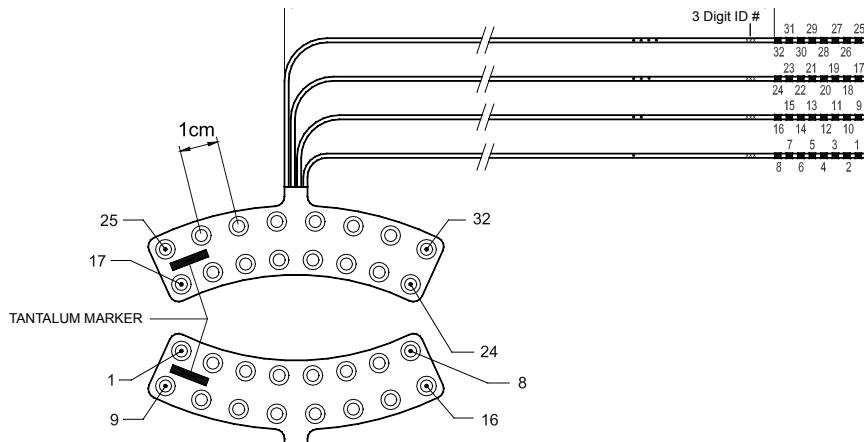

**Elektrode mit 32 Kontakten**

Katalog-Nr.	Spezifikationen
<b>AU8X2P4CD</b>	AURAGEN™ MIT 32 KONTAKTEN KABEL: ECCFS32

Die Kontakte sind mit der Oberseite nach oben abgebildet

# Epidurale Peg-Elektroden

## Epidurale Peg-Elektroden

Peg-Elektroden werden in der Regel in einem Bohrloch positioniert, damit die Hirntätigkeit extradural aufgezeichnet werden kann. Sie haben Platin-Kontakte und sind in mehreren Längen erhältlich, um verschiedenen Schäeldicken gerecht zu werden. Für die Einbringung von Peg-Elektroden im Patienten eignet sich ein 4,6-mm-Spiralbohrer.

Katalog-Nr.	Länge (L)
<b>EP3</b>	3 MM
<b>EP5</b>	5 MM
<b>EP7</b>	7 MM
<b>EP9</b>	9 MM
<b>EP11</b>	11 MM
<b>EP13</b>	13 MM
<b>EP15</b>	15 MM
<b>EP17</b>	17 MM
<b>EP19</b>	19 MM




Katalog-Nr.	Spezifikationen
<b>EDSCF</b>	EEG-ANSCHLUSSKABEL FÜR EP-ELEKTRODEN MIT BUCHSENKONTAKTEN




## Sphenoidalelektroden

Sphenoidalelektroden stellen ein weniger invasives Verfahren dar, um die Hirntätigkeit bei Epilepsiepatienten aufzuzeichnen. Sphenoidalelektroden werden aus Platinmaterial hergestellt.

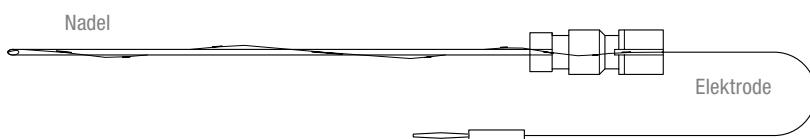

Katalog-Nr.	Spezifikationen
<b>EDSEP</b>	SPHENOIDALELEKTRODE MIT PLATIN-EINFÜHRNADEL



Katalog-Nr.	Spezifikationen
<b>EDSCF</b>	EEG-ANSCHLUSSKABEL FÜR EP-ELEKTRODEN MIT BUCHSENKONTAKTEN


# Elektroden-Anschlusskabel

## CamLock-Anschlussystem

Das CamLock-Anschlussystem ermöglicht schnelle und sichere Elektrodenanschlüsse (wird nicht steril verkauft).

Anschlusskabel – 2,4 m, 2 Teile mit Breakaway-Vorrichtung zum sicheren Lösen oder zur schnellen Abtrennung vom Patienten


Katalog-Nr.	Spezifikationen
ECCFS02	KABEL MIT 2 KONTAKTEN
ECCFS04	KABEL MIT 4 KONTAKTEN
ECCFS06	KABEL MIT 6 KONTAKTEN
ECCFS08	KABEL MIT 8 KONTAKTEN
ECCFS10	KABEL MIT 10 KONTAKTEN
ECCFS12	KABEL MIT 12 KONTAKTEN
ECCFS16	2X8 ANSCHLUSSKABEL
ECCFS20	2X10 ANSCHLUSSKABEL
ECCFS24	2X12 ANSCHLUSSKABEL
ECCFS32	4X8 ANSCHLUSSKABEL
ECCFS48	6X8 ANSCHLUSSKABEL
ECCFS64	8X8 ANSCHLUSSKABEL

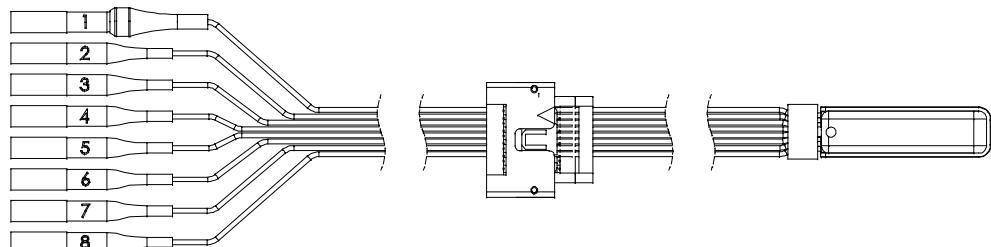

\* Breakaway-Vorrichtung (nur bei ECCFS-Kabeln)

Anschlusskabel – zyl. Anschl., 16 Kontakte, 2,4 m

Katalog-Nr.	Spezifikationen
17185C16	1X16 ANSCHLUSS
17185C32	2X16 ANSCHLUSS
17185C48	3X16 ANSCHLUSS
17185C64	4X16 ANSCHLUSS

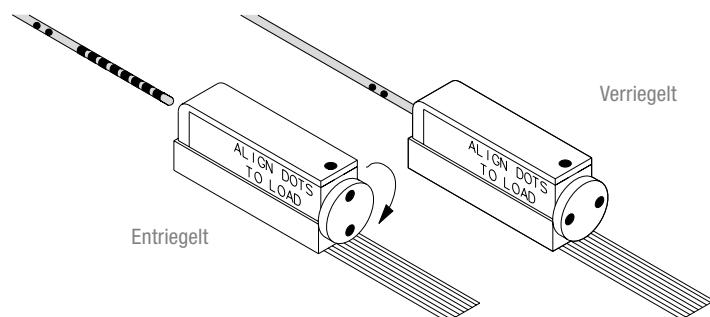

## Mikro-Anschlusskabel

Mikrokonnektor, mit Buchsenkontakte, 2,5 m

Katalog-Nr.	Spezifikationen
EDSCF	ANSCHLUSSKABEL FÜR PEG- UND SPHENOIDALELEKTRODEN



## Ojemann-Kortexstimulator

Der in Zusammenarbeit mit Dr. George Ojemann an der Universität Washington entwickelte Ojemann-Kortexstimulator ist der Industriestandard für kortikale Stimulationsverfahren. Dieses tragbare Konstantstrom-Gerät zeichnet sich durch einfache, unkomplizierte Bedienungselemente aus und seine Stromeinstellungen eignen sich für wache oder anästhesierte Patienten. Der Ojemann-Kortexstimulator ist ein kompaktes, batteriebetriebenes Gerät, das bis zu 20 Milliampere Strom (Scheitel zu Scheitel) zuführt.

Katalog-Nr.	Spezifikationen
OCS2	OJEMANN-KORTEXSTIMULATOR
OCS2PND	OJEMANN-KORTEXSTIMULATOR-SONDE



## Referenzen

17185C16 .....	13	AU8X2P4CD .....	10
17185C32 .....	13	AU8X4P14 .....	6
17185C48 .....	13	AU8X8P14S .....	7
17185C64 .....	13	AU8X8P4 .....	7
AU1X2P .....	1	AU8X8P4M4 .....	7
AU1X4P .....	1	AU8X8P4M75 .....	7
AU1X4PD .....	3	AU8X8P4S .....	7
AU1X6P .....	1	AU8X8P4V .....	7
AU1X6PD .....	3	AU8X8P8 .....	5
AU1X6PM75 .....	1	ECCFS02 .....	13
AU1X8P .....	2	ECCFS04 .....	13
AU1X8PD2 .....	3	ECCFS06 .....	13
AU1X10P .....	2	ECCFS08 .....	13
AU1X12P .....	2	ECCFS10 .....	13
AU2X4P1 .....	4	ECCFS12 .....	13
AU2X6P1 .....	4	ECCFS16 .....	13
AU2X8P1 .....	6	ECCFS20 .....	13
AU2X8P2 .....	4	ECCFS24 .....	13
AU4X2P1C .....	8	ECCFS32 .....	13
AU4X2P2CD .....	9	ECCFS48 .....	13
AU4X4P1 .....	4	ECCFS64 .....	13
AU4X5P2 .....	4	EDSCF .....	11, 12, 13
AU4X5P12 .....	5	EDSEP .....	12
AU4X6P2 .....	5	EP3 .....	11
AU4X8P4 .....	5	EP5 .....	11
AU4X8P2 .....	6	EP7 .....	11
AU5X8P15 .....	5	EP9 .....	11
AU6X2P1C .....	8	EP11 .....	11
AU6X2P2CD .....	9	EP13 .....	11
AU6X8P3 .....	6	EP15 .....	11
AU6X8P6 .....	5	EP17 .....	11
AU8X1P .....	2	EP19 .....	11
AU8X2P2C .....	8	OCS2 .....	14
AU8X2P2CDL .....	10	OCS2PND .....	14

# Stichwortverzeichnis - alphabetisch

## 0-9

3D-konformes Gitter 8x8 .....	7
-------------------------------	---

## D

Doppelseitige kortikale Streifenelektrode mit zylindrischem Konnektor .....	3
---	---

## E

Elektroden-Anschlusskabel .....	13
Epidurale Peg-Elektroden.....	11

## G

Gekrümmte doppelseitige Gitterelektrode mit zylindrischem Konnektor.....	9-10
Gekrümmte Gitterelektrode mit zylindrischem Konnektor .....	8
Gitterelektroden.....	4-10

## K

Kabel .....	13
Kortikale Gitterelektrode mit zylindrischem Konnektor.....	4-7
Kortikale Streifenelektrode mit zylindrischem Konnektor .....	1-2

## O

Ojemann-Kortexstimulator .....	14
--------------------------------	----

## S

Sphenoidalelektroden .....	12
----------------------------	----

## Z

Zylindrische Anschlusskabel .....	13
-----------------------------------	----

Die in diesem Katalog enthaltenen Angaben und Abbildungen gelten als Richtlinien und dienen lediglich illustrativen Zwecken. Die Informationen in diesem Katalog ersetzen nicht die Gebrauchsanweisung, die jedem Integra-Produkt beiliegt. Klinische Anweisungen sind der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Produkts zu entnehmen. Technische und weitere klinische Informationen zu Integra Produkten erhalten Sie bei Ihrem Integra Neurospezialisten.  
Auragen, Integra Brain Mapping und das Integra Wellen-Logo sind Marken der Integra LifeSciences Corporation oder ihrer Tochterunternehmen.



**Integra LifeSciences Services (France) SAS**  
Immeuble Séquoia 2 • 97 allée Alexandre Borodine  
Parc technologique de la Porte des Alpes  
69800 Saint Priest • FRANCE  
[www.Integra-LS.com](http://www.Integra-LS.com)

**Frankreich / International**  
+33 (0) 437 47 59 00  
+33 (0) 437 47 59 99 (Fax)

**Großbritannien / Nordirland**  
+44 (0) 1264 345 700  
+44 (0) 1264 332 113 (Fax)

**Benelux**  
+32 (0) 2 257 41 30  
+32 (0) 2 253 24 66 (Fax)

**Deutschland**  
+49 (0) 0800 10 10 755  
+49 (0) 2102 5536 636 (Fax)

**Schweiz**  
+41 22 721 23 00  
+41 22 721 23 99 (Fax)