



**Integra  
Ultrasonics  
CUSA® NXT**  
Catalogo prodotti

## Informazioni su ordini e garanzia

### Prezzi:

I prezzi indicati in specifici preventivi scritti restano validi per trenta giorni dalla data riportata; altrimenti sono soggetti a modifica senza preavviso. I termini di pagamento indicati in accordi scritti sono disciplinati in base a tali accordi.

### Requisiti minimi di ordine:

Il requisito minimo per gli ordini è pari a € 250 (saranno aggiunti € 20 di spese di gestione dell'ordine a ogni ordine inferiore a € 250).

### Spese amministrative:

Per ciascun ordine, sarà applicato un importo per spese amministrative pari a € 25, GBP 250, CHF 30.

### Procedura per ordinare:

È possibile che venga richiesto un ordine d'acquisto scritto sul modulo del cliente, per gli acquisti di prodotti Integra LifeSciences.

### Accettazione degli ordini:

Gli ordini vengono accettati su approvazione del Servizio clienti Integra.

### Politica dei resi:

- Prima della restituzione di un prodotto, occorre ottenere l'autorizzazione da parte del servizio clienti.
- I prodotti sterili devono essere restituiti nel contenitore non aperto, senza danni, confezionati in modo da evitare danni.
- I prodotti non sterili devono essere restituiti non utilizzati, in condizioni rivendibili e nella confezione originale.
- Non saranno accettati per l'accreditto prodotti su ordini personalizzati o speciali.
- Sarà emesso un credito per le merci restituite entro i novanta giorni dalla data di spedizione, dopo aver sottratto le spese di ripristino dello stock pari al 20%. Tale operazione si fonda sul presupposto che i prodotti non siano danneggiati e che ci si possa accertare che non siano stati utilizzati o aperti.

## Garanzia INTEGRA per Aspiratore chirurgico a ultrasuoni CUSA® NXT

### 1. Garanzia.

INTEGRA LIFESCIENCES CORPORATION e le sue società interamente controllate («INTEGRA») garantisce ai distributori autorizzati INTEGRA e al primo acquirente esclusivamente che ogni nuovo Aspiratore chirurgico a ultrasuoni CUSA® NXT. L'aspiratore (di seguito indicato come Apparecchiatura o prodotto) è esente da difetti di fabbricazione inerenti a materiali e lavorazione, se sottoposto a un utilizzo e a una manutenzione normali, per un periodo di un (1) anno (tranne se espressamente previsto diversamente riguardo ad articoli accessori) dalla data della fattura emessa da INTEGRA (o dal suo distributore autorizzato) al primo acquirente, ma in nessun caso dopo la data di scadenza indicata sull'etichettatura di ciascun prodotto (indicato di seguito come Periodo di garanzia). Ai fini dei prodotti venduti da INTEGRA attraverso un distributore autorizzato di INTEGRA, nell'espressione "primo acquirente" rientra l'acquirente di prodotti INTEGRA a cui il distributore ha inizialmente venduto i prodotti. Di seguito, il primo acquirente sarà indicato come Cliente.

1.1. **Copertura.** Durante il Periodo di garanzia, INTEGRA fornirà gratuitamente l'assistenza e la manutenzione in linea con le disposizioni della Sezione 3 di tale Garanzia, in modo che l'Apparecchiatura sia conforme alle specifiche descritte nel Manuale dell'operatore dell'Aspiratore chirurgico a ultrasuoni CUSA® NXT, nella forma in cui il Manuale dell'operatore possa essere modificato da Integra di volta in volta (le "Specifiche tecniche").

1.2. **Esclusioni.** La Garanzia non si applicherà in alcun modo all'assistenza o alla manutenzione dell'Apparecchiatura o alla sostituzione di suoi componenti, in relazione a:

- i. utilizzo dell'Apparecchiatura con punte chirurgiche e condotti non fabbricati da INTEGRA LifeSciences;
- ii. difetti derivanti da materiali o componenti forniti, modificati o progettati da

### Servizi ai clienti:

#### Internazionale

+33 (0) 437 47 59 50  
+33 (0) 437 47 59 25 (Fax)  
csemea@integralife.com

#### Francia

+33 (0) 437 47 59 10  
+33 (0) 437 47 59 29 (Fax)  
custsvfrance@integralife.com

#### Benelux

+32 (0) 2 257 4130  
+32 (0) 2 253 2466 (Fax)  
custsvcbenelux@integralife.com

#### Regno Unito

+44 (0) 1264 312 725  
+44 (0) 1264 312 821 (Fax)  
custsvcsuk@integralife.com

#### Germania

+49 (0) 2102 5535 6200  
+49 (0) 2102 5536 636 (Fax)  
custsvcgermany@integralife.com

#### Svizzera

+41 22 721 23 30  
+41 22 721 23 99 (Fax)  
custsvcsuisse@integralife.com

#### Italia

+39 (0) 2 577 89 21  
+39 (0) 2 575 113 71 (Fax)  
custsvcitaly@integralife.com

soggetti diversi da un rappresentante dell'assistenza INTEGRA autorizzato ("Agente autorizzato" INTEGRA);

- iii. difetti scaturiti da procedure non corrette o non accurate di installazione, conservazione o utilizzo dell'Apparecchiatura o di qualsiasi suo componente, tra cui, senza pretesa di esaustività, all'utilizzo dell'Apparecchiatura non conforme alle istruzioni riportate nel Manuale dell'operatore;
- iv. difetti derivanti da metodi di pulizia e sterilizzazione inappropriati o trascurati oppure da manutenzione non corretta dell'Apparecchiatura;
- v. difetti derivanti da interventi di riparazione o assistenza sull'Apparecchiatura effettuati da soggetti diversi da INTEGRA o da suoi rappresentanti autorizzati;
- vi. difetti derivanti da danni accidentali all'Apparecchiatura, calamità naturali, danni dell'impianto elettrico, problemi di funzionamento dell'apparecchiatura, stress inconsueto, danni dell'impianto elettrico, problemi di funzionamento dell'apparecchiatura, inconsuete condizioni di esercizio;
- vii. usura e deterioramento normali.

### 2. Interventi di assistenza, riparazione e sostituzione.

- 2.1. **Assistenza e riparazioni.** Ogni intervento di assistenza e riparazione coperto dalla presente Garanzia potrebbe essere indicato di seguito come "riparazioni in garanzia" e ogni intervento di assistenza e riparazioni non coperte della presente Garanzia potrebbe essere indicato come "riparazioni fuori garanzia". L'unico obbligo di INTEGRA relativo alle riparazioni in garanzia riguarderà l'effettuazione di tutte

le regolazioni e le riparazioni necessarie secondo la presente Garanzia. INTEGRA addeberà al Cliente tariffe ordinarie di INTEGRA per qualsiasi riparazione fuori garanzia eseguita da INTEGRA.

- 2.2. Sostituzione dell'Apparecchiatura. L'Apparecchiatura difettosa o suoi componenti di cui si effettua la sostituzione in conformità alla Garanzia apparterranno a INTEGRA. INTEGRA si riserva il diritto di evadere le richieste di parti di ricambio utilizzando pezzi ricondizionati, a condizione che tali pezzi siano funzionalmente equivalenti ai pezzi nuovi e siano dotati della stessa garanzia dei pezzi sostituiti.
- 2.3. Notifica. Per poter esercitare i suoi diritti previsti dalla Garanzia, il Cliente o i distributori autorizzati INTEGRA devono notificare immediatamente a INTEGRA qualsiasi difetto e fornire a INTEGRA ogni opportunità di ispezionare e correggere i difetti.

### 3.3. Componenti e servizi relativi alle riparazioni.

3.1. Rientrano nella Garanzia i seguenti servizi:

- 3.1.1. *Console.* INTEGRA effettuerà, se possibile, interventi di riparazione in sede di console oppure sostituirà una console con una console nuova o ricondizionata (a discrezione di INTEGRA), secondo il caso; ove non sia possibile INTEGRA disporrà e pagherà la spedizione dell'Apparecchiatura interessata alla designata officina di riparazione e provvederà alla riparazione dell'Apparecchiatura interessata.
- 3.1.2. *Manipoli.* INTEGRA sostituirà qualsiasi manipolo difettoso coperto dalla Garanzia con un manipolo nuovo o ricondizionato (a discrezione di INTEGRA), che sarà dotato della stessa garanzia dell'apparecchiatura originale ("Manipolo di scambio").
- 3.2. *Modifiche all'Apparecchiatura oggetto della copertura.* Di tanto in tanto, a sua esclusiva discrezione, INTEGRA potrebbe proporre modifiche da apportare all'Apparecchiatura coperta e alle Specifiche tecniche relative all'Apparecchiatura. Fatta salva l'approvazione del Cliente e a suo esclusivo carico, il Cliente può chiedere a INTEGRA di apportare tali modifiche all'Apparecchiatura e alle Specifiche tecniche rientranti nella copertura. INTEGRA apporterà tali modifiche per il Cliente; tali modifiche potrebbero riguardare l'installazione di nuovi componenti sull'Apparecchiatura, al prezzo pari al listino prezzi vigente in quel momento per tali modifiche, il quale viene fissato da INTEGRA a sua esclusiva discrezione.

### 4. Controllo di qualità.

- 4.1. Il Cliente dovrà mantenere standard ragionevoli in termini di controllo della qualità, procedure, prove di sicurezza e ispezione dell'Apparecchiatura, per garantire che non siano richiesti di conseguenza interventi di assistenza e manutenzione non necessari.
- 4.2. Il Cliente dovrà indicare al Rappresentante dell'assistenza INTEGRA una controparte tecnica, che favorisca la diagnosi telefonica di INTEGRA riguardo ai problemi di funzionamento dell'Apparecchiatura. Il Cliente dovrà accettare in modo ragionevole la decisione di INTEGRA riguardo al fatto che si tratti di un intervento di riparazione o assistenza in garanzia o di una riparazione fuori garanzia.

### 5. Limitazione della responsabilità.

- 5.1. L'unica responsabilità civile di INTEGRA ai sensi delle garanzie descritte nella Sezione 1 considererà nella riparazione o nella sostituzione, a esclusiva discrezione di INTEGRA e a spese di INTEGRA, fatti salvi i termini della presente garanzia e gli accordi vigenti. LE GARANZIE DESCRITTE NELLASEZIONE 1 DEL PRESENTE ATTO HANNO CARATTERE DI ESCLUSIVITÀ E SONO FORNITE E ACCETTATE IN SOSTITUZIONE DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE DA PARTE DI INTEGRA O SUOI RAPPRESENTANTI DELL'ASSISTENZA, IN RELAZIONE ALLA QUALITÀ, ALLE PRESTAZIONI E AL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA, IN FORMA SCRITTA OD ORALE, ESPRESSE O IMPLICITE, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIANO ATTRIBUIBILI A INTERVENTI D'ASSISTENZA ESEGUITI NELL'AMBITO DELLA GARANZIA. CON LA PRESENTE DICHIARAZIONE SI DECLINANO TUTTE LE ALTRE ATTESTAZIONI O GARANZIE DI INTEGRA O SUOI RAPPRESENTANTI, ESPRESSE O IMPLICITE, IN RELAZIONE ALL'APPARECCHIATURA O AI SERVIZI, LA DIAGNOSI, LA CONSULENZA, L'ASSISTENZA O I COMPONENTI DA PREVENTIVARE NELL'AMBITO DELLA GARANZIA, TRA CUI (SENZA PRETESA DI ESAUSTIVITÀ) LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER PARTICOLARI SCOPI. IN NESSUN CASO INTEGRA, I SUOI MANDATARI O I SUOI RAPPRESENTANTI DELL'ASSISTENZA SARANNO RESPONSABILI DI PERDITE INERENTI ALL'USO, ALLE ENTRATE O GLI UTILI O QUALESiasi ALTRO DANNO INDIRETTO, ACCESSORIO, ESEMPLARE, CONSEQUENTE, SPECIALE O DI ALTRO TIPO, A PRESCINDERE CHE DERIVINO DA CONTRATTO O ATTO ILLECITO, IN VIRTÙ DELLA GARANZIA O QUALESiasi PRESTAZIONE O VIOLAZIONE DA PARTE DI INTEGRA, SUOI MANDATARI O RAPPRESENTANTI DELL'ASSISTENZA PER MEZZO DEL PRESENTE ATTO O AI SENSI DELLO

STESSO.

- 5.2. 5.2. Il Cliente accetta che, malgrado l'assistenza tecnica fornita da INTEGRA o suoi rappresentanti ai sensi della Garanzia, il Cliente sarà integralmente ed esclusivamente responsabile di tutti i trattamenti eseguiti o tentati con l'Apparecchiatura. INTEGRA NON ESPRIME ALCUNA ATTESTAZIONE O GARANZIA IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'APPARECCHIATURA O DELL'ASSISTENZA TECNICA CHE SARÀ FORNITA DA INTEGRA, DA SUOI MANDATARI O RAPPRESENTANTI DELL'ASSISTENZA, AI FINI DEL PARTICOLARE TRATTAMENTO CHE IL CLIENTE INTENDE ESEGUIRE PER SOGGETTI TERZI. Inoltre, INTEGRA declina qualsiasi responsabilità in relazione all'efficacia dell'Apparecchiatura o della suddetta assistenza tecnica o riguardo a qualsiasi rivendicazione di soggetti terzi correlata a qualunque trattamento eseguito dal Cliente.
- 5.3. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA HA CARATTERE ESCLUSIVO E SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESI TUTTI GLI ALTRI OBBLIGHI O RESPONSABILITÀ DA PARTE DI INTEGRA O DEI SUOI DISTRIBUTORI E INTEGRA NON SI ASSUME NÉ AUTORIZZA ALCUN RAPPRESENTANTE O ALTRO SOGGETTO AD ASSUMERE A SUO NOME QUALESiasi ALTRA RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE AI PRODOTTI INTEGRA. INTEGRA DECLINA TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESA OGNI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ A PARTICOLARI SCOPI O APPLICAZIONI, NÉ GARANZIE DI QUALITÀ, NONCHÉ QUALESiasi GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA NEI RIGUARDI DEI PAZIENTI. Non può scaturire alcuna garanzia o avallo da atti o dichiarazioni, né la presente Garanzia standard può essere modificata in alcun modo, se non a seguito di un atto scritto sottoscritta da un funzionario di INTEGRA. Tali limitazioni sulla creazione o modifica di questa garanzia non possono essere oggetto di rinuncia o modifica in forma verbale, né attraverso alcun comportamento.
- 5.4. IN NESSUN CASO INTEGRA AUTORIZZERÀ I DISTRIBUTORI AD ASSUMERE RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEL CLIENTE PER QUALESiasi DANNO ACCESSORIO, INDIRETTO, CONSEGUENTE O PUNITIVO IN RELAZIONE ALL'ACQUISTO O ALL'UTILIZZO DI QUALESiasi PRODOTTO INTEGRA. Inoltre, la presente garanzia non si applicherà e i distributori autorizzati INTEGRA non saranno responsabili nei riguardi del Cliente in relazione ad alcuna perdita, insorgente in connessione con l'acquisto o l'utilizzo di qualsiasi prodotto INTEGRA affidato alla riparazione da parte di chiunque non sia un rappresentante dell'assistenza autorizzato INTEGRA, oppure sia stato alterato in qualsiasi modo capace di incidere sulla sua stabilità o affidabilità, oppure che sia stato sottoposto a un uso scorretto, trascuratezza o incidente, oppure che sia stato utilizzato in forme diverse da quelle indicate nelle istruzioni fornite da INTEGRA. QUESTA GARANZIA LIMITATA DEI DISTRIBUTORI INTEGRA HA CARATTERE DI ESCLUSIVITÀ E SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA NEI CONFRONTI DEL CLIENTE, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESI TUTTI GLI ALTRI OBBLIGHI O RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEL CLIENTE DA PARTE DEI DISTRIBUTORI AUTORIZZATI INTEGRA. I DISTRIBUTORI AUTORIZZATI INTEGRA DECLINANO OGNI ALTRA GARANZIA NEI CONFRONTI DEL CLIENTE, GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESA OGNI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ A PARTICOLARI SCOPI E APPLICAZIONI, NÉ GARANZIE DI QUALITÀ, NONCHÉ QUALESiasi GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA NEI RIGUARDI DEI PAZIENTI O ALTRI SOGGETTI TERZI.
- 5.5. Forza maggiore. In deroga a eventuali disposizioni contrarie contenute nel presente documento, se le prestazioni previste dalla Garanzia da parte di INTEGRA, di distributori autorizzati INTEGRA o del Cliente o qualsiasi obbligo in capo a INTEGRA, ai distributori autorizzati INTEGRA o al Cliente conseguenti al presente documento subiscono impedimenti, limitazioni o interferenze a causa di incendi, esplosioni, calamità naturali, controversie sindacali o incidenti capaci di influenzare le prestazioni previste dalla Garanzia, oppure situazioni di guerra, mobilitazione, sommosse, blocchi o embargo, oppure eventuali leggi, regolamenti, decreti o requisiti futuri emessi da qualsiasi governo o ente di regolamentazione o qualsiasi altro atto, in qualche modo assimilabile a quelli sopra elencati, o qualsiasi altra circostanza al di là del ragionevole controllo di INTEGRA, distributori autorizzati di INTEGRA o del Cliente, in tali condizioni, INTEGRA, i distributori autorizzati INTEGRA o il cliente, a seconda dei casi, dovranno tempestivamente comunicare alla controparte le difficoltà derivanti e qualsiasi dei suddetti eventi rappresenterà una giustificazione riguardante qualsiasi prestazione imposta nell'ambito della Garanzia.

## Indice

<b>Informazioni su ordini e garanzia</b>	<b>3</b>
<b>Configurazioni base consigliate</b>	<b>5</b>
<b>Manipoli e punte Neuro</b>	<b>6</b>
Manipolo lungo 24 kHz Neuro	6
Manipolo corto 24 kHz Neuro	6
Manipolo 35 kHz Neuro	7
Manipolo microchirurgico 24 kHz Neuro	7
<b>Manipoli e punte Fegato</b>	<b>8</b>
Manipolo retto 24 kHz	8
Manipolo angolare 24 kHz	8
Manipolo retto 35 kHz	9
Manipolo laparoscopico 24 kHz	9
<b>Console</b>	<b>10</b>
<b>Accessori</b>	<b>10</b>
<b>Indicazioni e controindicazioni</b>	<b>11</b>


**Configurazioni base consigliate**


N. catalogo	Descrizione	Quantità per uso Neuro	Quantità per uso Fegato
<b>CUSANXT</b>	Console CUSA® NXT 220 v - 230 v, con interruttore a pedale in dotazione	1	1
<b>CUSANXT2</b>	Modulo di servizio CUSA® NXT 220 v - 230 v	1	1
<b>NXT80002</b>	Cavo alimentazione, Europa	1	1
<b>NXT80003</b>	Cavo alimentazione, Regno Unito	1	1
<b>NXT00005</b>	Filtro anticontaminazione	1 Conf. 2 pz.	1 Conf. 2 pz.
<b>1523000M7</b>	Manipolo corto 24 kHz Neuro	1	
<b>1523215</b>	Punta corta 24 kHz Neuro e copripunta monouso	1 Conf. 5 pz.	
<b>1523000M9</b>	Manipolo 35 kHz Neuro	1	
<b>1523235</b>	Punta 35 kHz Neuro e copripunta monouso	1 Conf. 5 pz.	
<b>1523000M1</b>	Manipolo retto 24 kHz		1
<b>1523013</b>	Punta retta standard riutilizzabile 24 kHz		1
<b>1523042</b>	Copripunta retti 24 kHz		1 Conf. 20 pz.
<b>1523000M3</b>	Manipolo retto 35 kHz		1
<b>1523014</b>	Punta retta standard riutilizzabile 35 kHz		1
<b>1523043</b>	Copripunta retti 35 kHz		1 Conf. 20 pz.
<b>1523072M3</b>	Manipolo Neuro set chiave	2	
<b>1523072M1</b>	Manipoli Fegato set chiave		2
<b>1517079</b>	Kit tubi monouso	1 Conf. 10 pz.	1 Conf. 10 pz.
<b>07289</b>	Vassoio di sterilizzazione	2	2
<b>1523101</b>	Spazzola per la pulizia porta di aspirazione	2	2



## Manipoli e punte Neuro

### Manipolo lungo 24 kHz Neuro

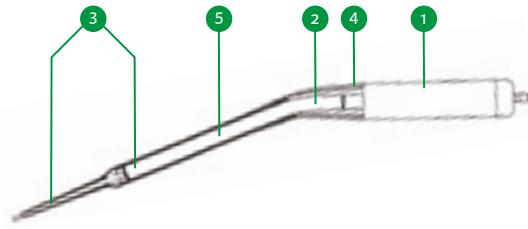


- 1 Trasduttore
- 2 Estensione angolare
- 3 Set punta

- 4 Rivestimento angolare
- 5 Estensione Copripunta

N. catalogo	Sterile	Descrizione	Quantità
1523000M5	No	Manipolo lungo 24 kHz Neuro <sup>1</sup>	1 cad.
1523225	Sì	Punta lunga 24 kHz Neuro e copripunta monouso	1 Conf. 5 pz.
1523049	No	Rivestimento angolare 24 kHz Neuro	1 cad.
1523052	No	Estensione angolare lunga 24 kHz Neuro	1 cad.


### Manipolo corto 24 kHz Neuro

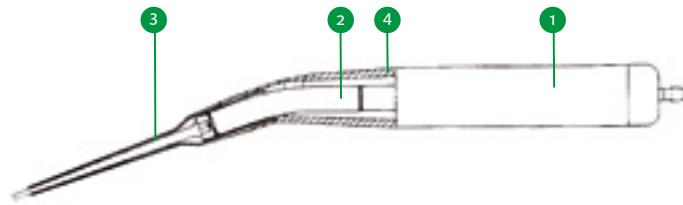

- 1 Trasduttore
- 2 Estensione angolare

- 3 Set punta
- 4 Rivestimento angolare

### Punte Ossio

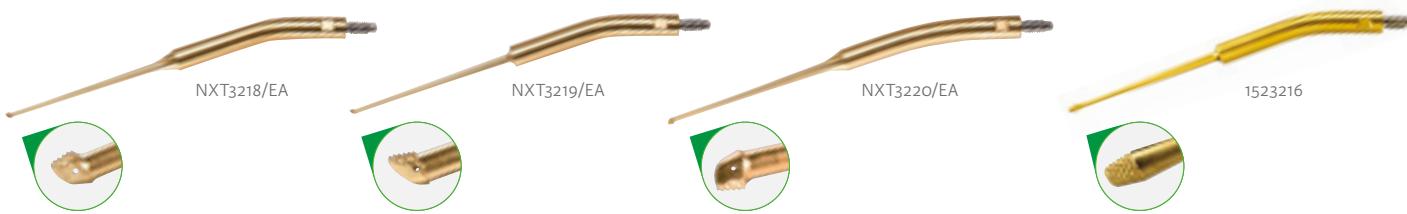


N. catalogo	Sterile	Descrizione	Quantità
1523000M7	No	Manipolo corto 24 kHz Neuro <sup>1</sup>	1 cad.
1523215	Sì	Punta corta Neuro e copripunta monouso	1 Conf. 5 pz.
1523216	Sì	Punta SaberTip™ 24 kHz e copripunta monouso	1 Conf. 5 pz.
NXT3218	Sì	Punta da osso superiore in avanti 24 kHz e copripunta monouso <sup>2/3</sup>	1 Conf. 5 pz.
NXT3218EA			1 cad.
NXT3219	Sì	Punta da osso superiore inversa 24 kHz e copripunta monouso <sup>2/3</sup>	1 Conf. 5 pz.
NXT3219EA			1 cad.
NXT3220	Sì	Punta da osso inferiore in avanti 24 kHz e copripunta monouso <sup>2/3</sup>	1 Conf. 5 pz.
NXT3220EA			1 cad.
1523049	No	Rivestimento angolare kHz Neuro	1 cad.
1523053	No	Estensione angolare corta 24 kHz Neuro	1 cad.

1. I manipoli sono forniti con rivestimento ed estensione, ma senza punta

2. Non compatibile con il sistema CUSA® Selector®

3. Non testato con MRI

## Manipolo 35 kHz Neuro

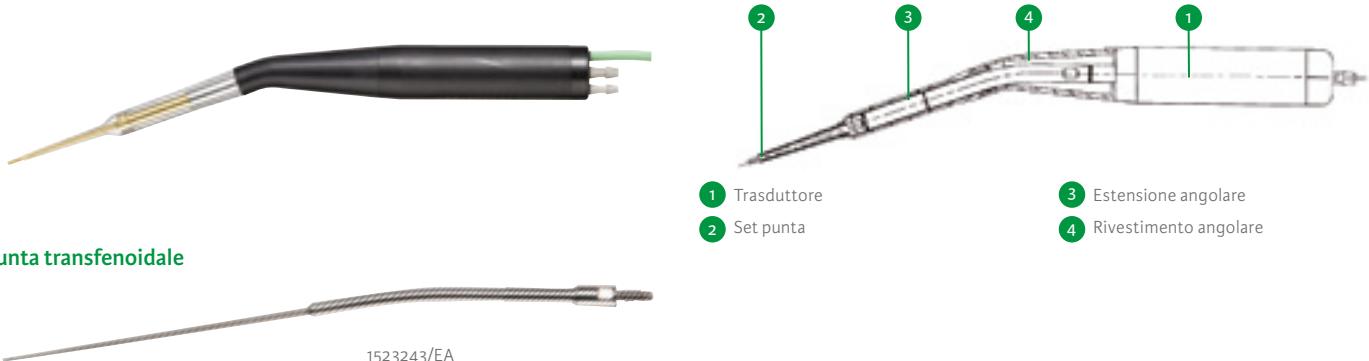

N. catalogo	Sterile	Descrizione	Quantità
1523000M9	No	Manipolo 35 kHz Neuro <sup>1</sup>	1 cad.
1523235	Sì	Punta 35 kHz Neuro e copripunta monouso	1 Conf. 5 pz.
1523064	No	Punta 35 kHz Neuro e copripunta riutilizzabile <i>1 punta / 5 copripunta</i>	1 cad.
1523243	Sì	Punta 35 kHz lunghezza estesa e copripunta monouso <sup>2/3</sup>	1 Conf. 5 pz.
1523243EA			1 cad.
1523060	No	Rivestimento angolare 35 kHz Neuro	1 cad.
1523058	No	Estensione angolare 35 kHz Neuro	1 cad.

## Manipolo microchirurgico 24 kHz Neuro



N. catalogo	Sterile	Descrizione	Quantità
1529000M2	No	Manipolo micro 24 kHz <sup>1</sup>	1 cad.
1529165	Sì	Punta micro 24 kHz e copripunta monouso	1 Conf. 5 pz.
1529161			1 cad.
1529063	No	Punta micro 24 kHz e copripunta riutilizzabile <i>1 punta / 5 copripunta</i>	1 cad.
1529024	No	Rivestimento angolare micro 24 kHz	1 cad.
1529043	No	Estensione angolare micro 24 kHz	1 cad.

1. I manipoli sono forniti con rivestimento ed estensione, ma senza punta


2. Non compatibile con il sistema CUSA® Selector®

3. Non testato con MRI




## Manipoli e punte Fegato

### Manipoli retti 24 kHz

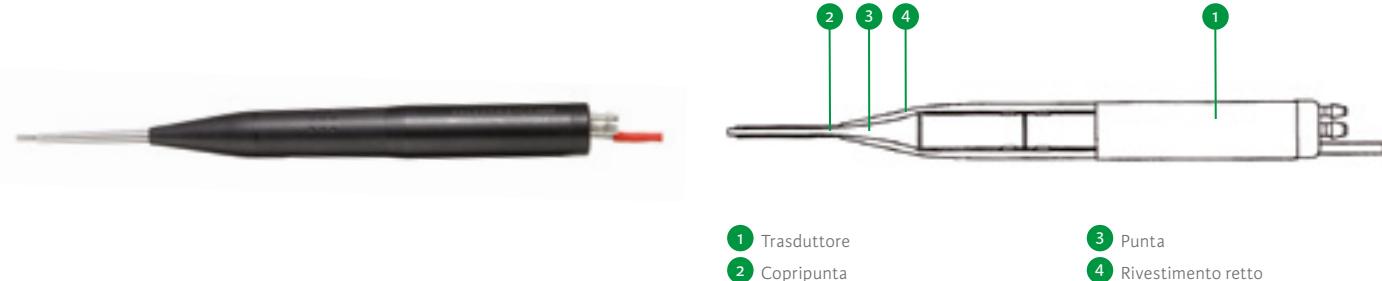

N. catalogo	Sterile	Descrizione	Quantità
1523000M1	No	Manipolo retto 24 kHz <sup>1</sup>	1 cad.
1523013	No	Punta retta standard riutilizzabile 24 kHz	1 cad.
1523042	No	Copripunta retti 24 kHz	1 Conf. 20 pz.
1523017	No	Rivestimento retto 24 kHz	1 cad.

### Manipolo angolare 24 kHz

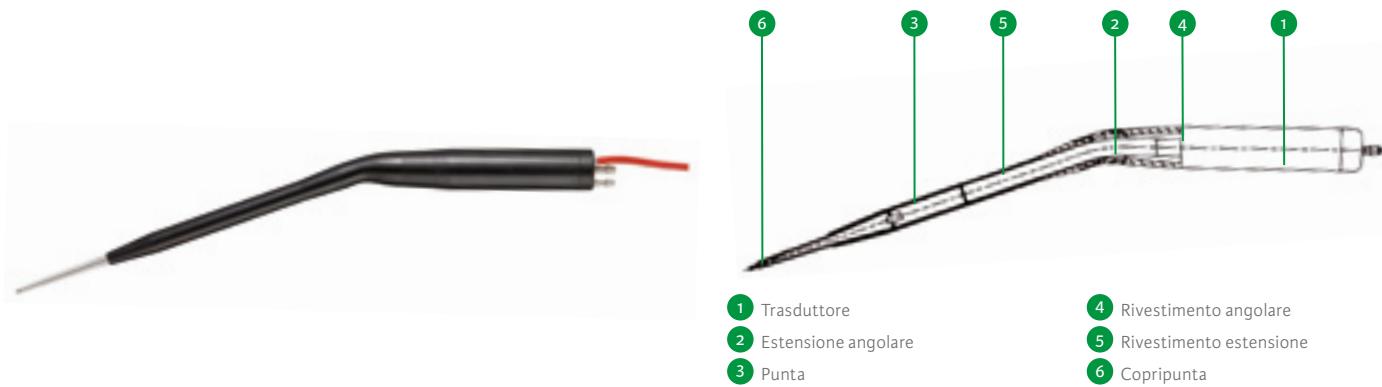

N. catalogo	Sterile	Descrizione	Quantità
1523000M2	No	Manipolo angolare 24 kHz <sup>1</sup>	1 cad.
1523015	No	Punta angolare standard riutilizzabile 24 kHz	1 cad.
1523042	No	Copripunta angolari 24 kHz	1 Conf. 20 pz.
1523049	No	Rivestimento angolare 24 kHz	1 cad.
1523035	No	Rivestimento estensione 24 kHz	1 cad.
1523033	No	Estensione angolare 24 kHz	1 cad.

1. I manipoli sono forniti con rivestimento ed estensione, ma senza punta

## Manipolo retto 35 kHz




1. Trasduttore  
2. Copripunta

3. Rivestimento retto  
4. Punta

N. catalogo	Sterile	Descrizione	Quantità
1523000M3	No	Manipolo retto 35 kHz <sup>1</sup>	1 cad.
1523014	No	Punta retta standard riutilizzabile 35 kHz	1 cad.
1523043	No	Copripunta retti 35 kHz	1 Conf. 20 pz.
1523018	No	Rivestimento retto 35 kHz	1 cad.

## Manipolo laparoscopico 24 kHz

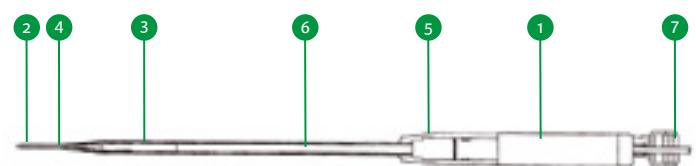

1. Trasduttore  
2. Copripunta  
3. Estensione  
4. Punta

5. Rivestimento  
6. Amplificatore passo  
7. Serratubi

N. catalogo	Sterile	Descrizione	Quantità
1523000M6	No	Manipolo laparoscopico 24 kHz <sup>1</sup>	1 cad.
1523029	No	Punta laparoscopica 24 kHz riutilizzabile	1 cad.
1523032	No	Copripunta laparoscopici 24 kHz	1 Conf. 10 pz.
1523030	No	Rivestimento laparoscopico 24 kHz	1 cad.

1. I manipoli sono forniti con rivestimento ed estensione, ma senza punta

## Console



NXT10001




F75320

N. catalogo	Sterile	Descrizione	Quantità
<b>CUSANXT</b>	No	Console CUSA® NXT 220 v - 230 v, con interruttore a pedale in dotazione	1 cad.
<b>CUSANXT2</b>	No	Modulo di servizio CUSA® NXT 220 v - 230 v	1 cad.
<b>F75320</b>	No	Trolley	1 cad.
<b>NXT80002</b>	No	Cavo alimentazione, Europa	1 cad.
<b>NXT80003</b>	No	Cavo alimentazione, Regno Unito	1 cad.
<b>NXT10001</b>	No	Interruttore a pedale	1 cad.

## Accessori



07289



1523101



NXTo0005



1523072M1/2/3 - 1529056

N. catalogo	Sterile	Descrizione	Quantità
<b>1517079</b>	Sì	Kit tubi monouso	1 Conf. 10 pz.
<b>1529036</b>	Sì	Estensione micro kit tubi monouso <i>da utilizzare con manipolo microchirurgico</i>	1 Conf. 10 pz.
<b>1532024</b>	Sì	Estensione kit tubi MRI monouso <i>da utilizzare con manipoli compatibili con MRI</i>	1 Conf. 10 pz.
<b>07289</b>	No	Vassoio di sterilizzazione	1 cad.
<b>1523101</b>	No	Spazzola per la pulizia porta di aspirazione manipolo	1 cad.
<b>NXTo0005</b>	No	Filtro anticontaminazione	1 Conf. 2 pz.
<b>1523072M3</b>	No	Manipoli Neuro set chiave	1 cad.
<b>1529056</b>	No	Manipolo Micro set chiave	1 cad.
<b>1523072M1</b>	No	Manipoli Fegato set chiave	1 cad.
<b>1523072M2</b>	No	Manipolo laparoscopico set chiave	1 cad.

## Note

### Indicazioni:

L'aspiratore chirurgico a ultrasuoni CUSA® NXT è destinato all'uso in procedure chirurgiche in cui sia desiderabile la frammentazione, l'emulsificazione e l'aspirazione di tessuto molle e duro (osseo), ad esempio neurochirurgia, chirurgia gastrointestinale e di organi affilati, chirurgia urologica, chirurgia plastica e ricostruttiva, chirurgia generale, chirurgia ortopedica, chirurgia ginecologica, chirurgia toracica, chirurgia laparoscopica e chirurgia toracoscopica.

### Controindicazioni:

Non si deve utilizzare l'aspiratore chirurgico a ultrasuoni CUSA® NXT per indicazioni diverse da quelle specificate nelle istruzioni per l'uso.



Distribuito da

**Vendite e marketing zona EMEA**  
 Integra LifeSciences Services (France) SAS  
 Immeuble Séquoia 2 ■ 97 allée Alexandre Borodine  
 Parc Technologique de la Porte des Alpes  
 69800 Saint Priest ■ FRANCIA  
 Tel.: +33 (0)4 37 47 59 00 telefono ■ Fax: +33 (0)4 37 47 59 99  
[emea.info@integralife.eu](http://emea.info@integralife.eu)

 **Integra LifeSciences (Ireland) Ltd**  
 IDA Business and Technology Park  
 Tullamore, Offaly, Ireland

**Servizi ai clienti**  
 Internazionale: +33 (0) 437 47 59 50 ■ +33 (0) 437 47 59 25 (Fax) ■ [csemea@integralife.com](mailto:csemea@integralife.com)  
 Francia: +33 (0) 437 47 59 10 ■ +33 (0) 437 47 59 29 (Fax) ■ [custsvfrance@integralife.com](mailto:custsvfrance@integralife.com)  
 Regno Unito: +44 (0) 1264 312 725 ■ +44 (0) 1264 312 821 (Fax) ■ [custsvcuk@integralife.com](mailto:custsvcuk@integralife.com)  
 Germania: +49 (0) 2102 5535 6200 ■ +49 (0) 2102 5536 636 (Fax) ■ [custsvgermany@integralife.com](mailto:custsvgermany@integralife.com)  
 Benelux: +32 (0) 257 4130 ■ +32 (0) 253 2466 (Fax) ■ [custsvbenelux@integralife.com](mailto:custsvbenelux@integralife.com)  
 Svizzera: +41 (0) 27 21 23 30 ■ +41 (0) 27 21 23 99 (Fax) ■ [custsvsuisse@integralife.com](mailto:custsvsuisse@integralife.com)  
 Italia: +39 (0) 577 89 21 ■ +39 (0) 575 113 71 (Fax) ■ [custsvitaly@integralife.com](mailto:custsvitaly@integralife.com)

©2016 Integra LifeSciences Corporation. Tutti i diritti riservati. 0315829-1-IT  
 DOCUMENTO ALL'USO ESCLUSIVAMENTE IN EUROPA, MEDIO ORIENTE E AFRICA.



La disponibilità di questi prodotti può variare da una nazione o regione a un'altra, in conseguenza di specifici requisiti normativi locali circa l'approvazione e le pratiche di dogana, in relazione alla vendita nella nazione o nella regione in oggetto. Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso. Documenti non contrattuale. Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso i prodotti, con lo scopo di migliorare la qualità. **AVVERTENZA:** Le leggi vigenti limitano la vendita di questo dispositivo ai soli medici o in base a una prescrizione medica. Integra e il logo Integra sono marchi registrati di Integra LifeSciences Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. CUSA e Selecto sono marchi registrati di Integra LifeSciences Corporation o sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. SabeTip è un marchio commerciale di Integra LifeSciences Corporation o sue società controllate. I prodotti citati nel presente documento appartengono alla classe di dispositivi CE I, IIb o III. Per qualsiasi altra informazione sulla classificazione dei dispositivi, si invita a rivolgersi al servizio clienti di Integra. Tutti i dispositivi medici citati nel presente documento sono contrassegnati con il marchio CE, ai sensi della Direttiva del Consiglio europeo 93/42/CEE sui dispositivi medici e ai relativi accessori, se non identificati specificamente come "SENZA MARCHIO CE". Ultima data di revisione: 04/2016.