



Integra®
Système de Drainage
Externe du LCR
Catalogue de vente

Commandes et Garanties	3
Systèmes de Drainage Externe Integra®	5
Système de Drainage Externe Premium	6
AccuDRAIN™ Système de Drainage Externe du LCR	6
Système de Drainage Externe Intermédiaire	8
Monté sur Panneau - INS8301	8
Monté sur Potence - INS8600 / 8601	9
Dispositif de Fixation sur Potence	9
Système de Drainage Externe Standard	10
Set de Drainage Externe - EDS	10
Set de Drainage Integral - IDS	11
Système de Drainage LCR Basique - Système de Drainage Ventriculaire	11
Cathéters et Accessoires Integra®	13
Cathéters Ventrictulaires	14
Cathéters Lombaires	17
Accessoires	18
Accès Crânien Integra®	21
Kit d'Accès Crânien	22
Perceuse à Main	23
Trépans	23
Produits de Drainage Spéciaux	25
Cathéter Sous-Dural de Mesure de la Pression Intracrânienne	26
Cathéter Sous-Dural & Kit	26
Poire de Drainage	26
Cathéter de Ponction de Kystes	26
Indications – Contre-indications	29
Index	33

*Limiter l'incertitude

Tarifs :

Les tarifs indiqués dans des devis écrits précis sont valides trente jours à compter de la date indiquée ; au delà de cette période, ils peuvent être modifiés à tout moment, sans préavis. Les conditions de tarifications indiquées dans les accords écrits sont régies par lesdits accords.

Frais de traitement administratif des commandes :

Pour toute commande, des frais administratifs d'un montant de 25 Euros ou 30 CHF s'appliqueront.

Commande minimum :

Le montant minimum par commande est de 250 € (Pour toute commande d'un montant inférieur, des frais de dossiers de 20 € seront appliqués).

Procédure de commande :

Le client peut avoir à remplir un bon de commande écrit pour acquérir des produits Integra LifeSciences.

Acceptation des commandes :

Les commandes sont acceptées dès lors que le service clients Integra donne son accord.

Retours :

- Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable du service clients.
- Les produits stériles doivent être retournés dans leur emballage d'origine non ouvert ; ils doivent être emballés de manière à ne pas être endommagés durant leur expédition.
- Les produits non stériles doivent être retournés à l'état neuf, dans leur emballage d'origine.
- Les produits personnalisés ou résultant de commandes spéciales ne peuvent être remboursés.
- Un avoir sera émis pour tous produits retournés dans les 90 jours suivant leur date de livraison, déduction faite de frais de 20 %, à condition qu'ils n'aient été ni endommagés, ni utilisés ou ouverts.

Garantie Limitée Integra

INTEGRA LIFESCIENCES CORPORATION et ses filiales (« INTEGRA ») garantissent aux distributeurs agréés de produits INTEGRA et à l'acheteur original uniquement, que chaque nouveau produit INTEGRA ne comporte aucun défaut de fabrication, et ce pour une utilisation normale pendant un an (sauf mention contraire accompagnant les accessoires) à compter de la date de livraison des produits par INTEGRA (ou son distributeur agréé) à l'acheteur original. Cette garantie ne s'applique en aucun cas au-delà des dates limites d'utilisation indiquées sur les produits. Pour les produits vendus par INTEGRA par l'intermédiaire d'un distributeur agréé, « l'acheteur original » inclut l'acheteur de produits INTEGRA auquel le distributeur vend initialement le produit.

- Les instruments chirurgicaux disposent d'une garantie de fabrication, à condition qu'ils soient nettoyés correctement et utilisés normalement dans le cadre des procédures prévues.
- Si les produits couverts par cette garantie ont été cédés par INTEGRA dans le cadre d'une location ou d'un achat par paiements échelonnés, en cas de réparations avant la fin du contrat de location / d'achat, ces réparations seront effectuées selon les conditions décrites dans ledit contrat.

Si le défaut couvert par la garantie se révèle pendant la période de garantie ou avant la fin du contrat de location / d'achat, l'acheteur ou le distributeur s'adresseront directement à INTEGRA. Si l'acheteur ou le distributeur souhaitent faire valoir la présente garantie, ils doivent retourner le produit concerné à INTEGRA. Le produit défectueux devra être retourné rapidement, dans un emballage correct et affranchi. En cas de perte ou dommage résultant de cet envoi à destination d'INTEGRA, les frais seront à la charge de l'expéditeur. Selon la présente garantie, INTEGRA est uniquement tenu de réparer ou échanger le produit, selon le choix d'INTEGRA, qui en assurera les frais, conformément aux conditions de cette garantie et aux accords applicables.

LA RESPONSABILITÉ DE INTEGRA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE ENGAGÉE AU TITRE DES DOMMAGES, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS EN RAPPORT AVEC L'ACQUISITION OU L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT INTEGRA. De plus, cette garantie ne saurait s'appliquer, et la société INTEGRA ne saurait être tenue responsable, dans le cas d'une quelconque perte en rapport avec l'achat ou l'utilisation de tout produit INTEGRA : réparé par une personne autre qu'un représentant du service après-vente d'INTEGRA, modifié d'une quelconque manière altérant sa stabilité ou sa fiabilité, ayant subi une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident, ou utilisé d'une manière autre que celle indiquée dans les instructions fournies par INTEGRA. CETTE GARANTIE LIMITÉE À DESTINATION DES DISTRIBUTEURS INTEGRA EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, FOURNIE À L'ACHETEUR ORIGINAL, ET TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ ENVERS L'ACHETEUR ORIGINAL DE LA PART DES DISTRIBUTEURS AGRÉÉS INTEGRA. LES DISTRIBUTEURS AGRÉÉS INTEGRA SE DÉGAGENT DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, FOURNIE À L'ACHETEUR ORIGINAL, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE TACITE DE VALEUR COMMERCIALE OU DE POSSIBILITÉ D'UTILISATION DANS UN BUT PRÉCIS, OU TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ, AINSI QUE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE FOURNIE AUX PATIENTS.

Services Clients**International**

+33 (0)4 37 47 59 50
+33 (0)4 37 47 59 25 (Fax)
csemea@integralife.com

Benelux

+32 (0)2 257 4130
+32 (0)2 253 2466 (Fax)
custsvcbenelux@integralife.com

France

+33 (0)4 37 47 59 10
+33 (0)4 37 47 59 29 (Fax)
custsvctrance@integralife.com

Royaume-Uni

+44 (0)1 264 345 780
+44 (0)1 264 363 782 (Fax)
custsvcs.uk@integralife.com

Suisse

+41 (0)2 27 21 23 30
+41 (0)2 27 21 23 99 (Fax)
custsvcsuisse@integralife.com

négligence ou un accident, ou utilisé d'une manière autre que celle indiquée dans les instructions fournies par INTEGRA. CETTE GARANTIE LIMITÉE D'INTEGRA EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, OU TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPUTABLE À INTEGRA OU À SES DISTRIBUTEURS ; INTEGRA N'ENDOSSE NI N'AUTORISE AUCUN REPRÉSENTANT NI TOUTE AUTRE PERSONNE À ENDOSSER POUR ELLE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ EN RAPPORT AVEC LES PRODUITS D'INTEGRA. INTEGRA SE DÉGAGE DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE TACITE DE VALEUR COMMERCIALE OU DE POSSIBILITÉ D'UTILISATION DANS UN BUT PRÉCIS, OU TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ, AINSI QUE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE FOURNIE AUX PATIENTS. Aucune garantie ne peut être créée par un quelconque document ou une quelconque déclaration ; cette garantie standard ne peut être modifiée en aucune manière, sauf dans le cas d'un document signé par un membre représentant légal de INTEGRA. Ces limites concernant la création ou la modification de la présente garantie ne peuvent être annulées ni modifiées verbalement ou d'une quelconque manière.

LA RESPONSABILITÉ DES DISTRIBUTEURS DE INTEGRA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE ENGAGÉE AU TITRE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECTS OU PUNITIFS EN RAPPORT AVEC L'ACQUISITION OU L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT INTEGRA. De plus, cette garantie ne saurait s'appliquer, et les distributeurs agréés d'INTEGRA ne sauraient être tenus responsables envers l'acheteur original, dans le cas d'une quelconque perte en rapport avec l'achat ou l'utilisation de tout produit INTEGRA : réparé par une personne autre qu'un représentant du service après-vente d'INTEGRA, modifié d'une quelconque manière altérant sa stabilité ou sa fiabilité, ayant subi une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident, ou utilisé d'une manière autre que celle indiquée dans les instructions fournies par INTEGRA. CETTE GARANTIE LIMITÉE À DESTINATION DES DISTRIBUTEURS INTEGRA EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, FOURNIE À L'ACHETEUR ORIGINAL, ET TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ ENVERS L'ACHETEUR ORIGINAL DE LA PART DES DISTRIBUTEURS AGRÉÉS INTEGRA. LES DISTRIBUTEURS AGRÉÉS INTEGRA SE DÉGAGENT DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, FOURNIE À L'ACHETEUR ORIGINAL, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE TACITE DE VALEUR COMMERCIALE OU DE POSSIBILITÉ D'UTILISATION DANS UN BUT PRÉCIS, OU TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ, AINSI QUE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE FOURNIE AUX PATIENTS.



Integra®
Système de
Drainage Externe

Système de Drainage Externe Monté sur Panneau


AccuDrain™ - Système de Drainage du LCR*

- Ligne patient avec tubulure de pression verte à rayures
- 2 sites de prélèvement sans aiguille
- Aération hydrophobe antimicrobienne
- Burette graduée en entonnoir de 75 ml : par incrément de 1 ml
- Robinet de la ligne patient
- Robinet de burette à quatre voies et à haut débit
- Onglet Squeeze-Lok™ permettant d'ajuster la hauteur de la burette
- Dispositif de niveau de ligne
- Poche de recueil de 700 mL
- Statut compatibilité IRM: Pour plus d'informations veuillez consulter la notice d'utilisation


Références Description

INS8400	Sans valve anti-retour
INS8401	Avec valve anti-retour

- Sans Latex
- Stérile, emballage individuel

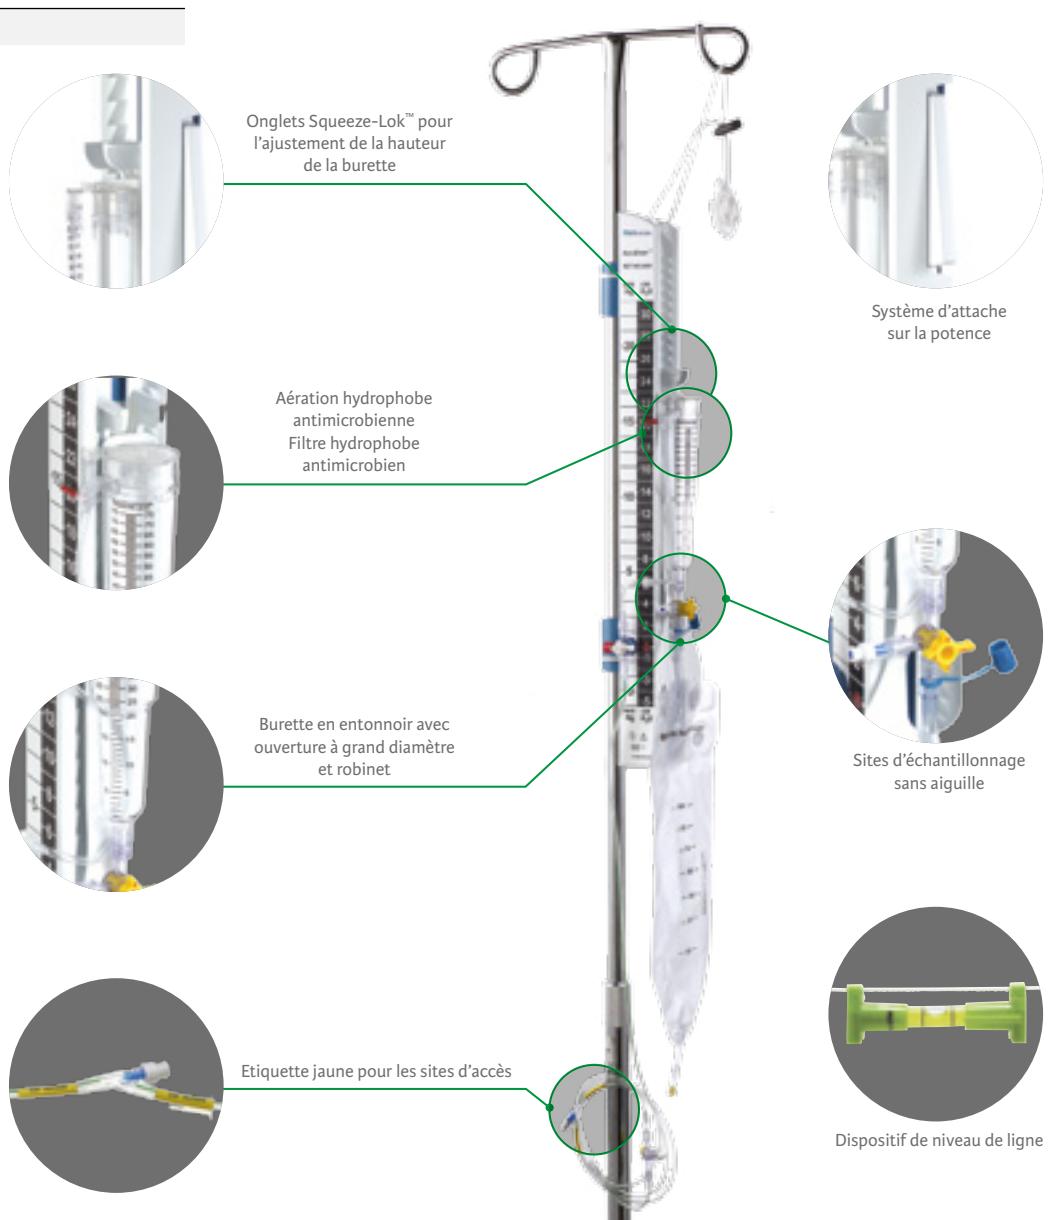

*Liquide Céphalo-Rachidien
Veuillez consulter la notice d'utilisation de ce produit pour des informations sur la compatibilité IRM

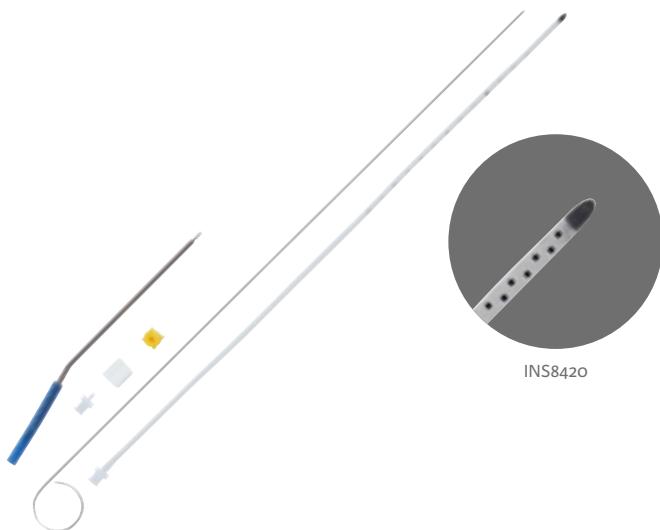

Cathéters ventriculaires et lombaires compatibles avec le système de drainage externe du LCR AccuDrain™ :

Références	Description
INS8220	Kit de cathéter ventriculaire Hermetic™
INS4000	Kit de cathéter ventriculaire Hermetic™, petite taille
INS4500	Kit de cathéter ventriculaire Hermetic™, grande taille
INS8420	Kit de cathéter ventriculaire TraumaCath™
INS5010	Kit de cathéter lombaire Hermetic™ à extrémité fermée
INS8330	Kit de cathéter lombaire Hermetic™ à extrémité ouverte

- Sans Latex
- Stérile, emballage individuel



Poche de recueil compatible avec le système de drainage externe du LCR AccuDrain™ :

Références	Description
INS8700	<ul style="list-style-type: none"> • Poche de recueil de recharge de 700 mL • Valve anti-retour

- Sans Latex
- Stérile, 5 unités par boîte

Système de Drainage Externe Monté sur Panneau

Hermetic™ Plus - Système de Drainage du LCR*

- Ligne du patient avec surveillance de pression verte à rayures
- 2 sites de prélèvement sans aiguille
- Aération hydrophobe antimicrobienne
- Burette graduée de 50 mL
- Robinet de la ligne patient
- Robinet de burette à quatre voies et à haut débit
- Attaches Velcro® & mécanisme de verrouillage à grande corde de suspension
- Poche de recueil de 700 mL
- Dispositif de niveau de ligne
- Statut compatibilité IRM: Pour plus d'informations veuillez consulter la notice d'utilisation



Références Description

INS8301	Sans valve anti-retour sur la ligne du patient
	<ul style="list-style-type: none"> • Sans Latex • Sterile, emballage individuel

Cathéters ventriculaire et lombaire compatible avec le système de drainage externe du LCR Hermetic™ Plus :

Références Description

INS8220	Kit de cathéter ventriculaire Hermetic™
INS4000	Kit de cathéter ventriculaire Hermetic™, petite taille
INS4500	Kit de cathéter ventriculaire Hermetic™, grande taille
INS8420	Kit de cathéter ventriculaire TraumaCath™
INS5010	Kit de cathéter lombaire Hermetic™ à extrémité fermée
INS8330	Kit de cathéter lombaire Hermetic™ à extrémité ouverte

- Sans Latex
- Sterile, emballage individuel

Poche de recueil compatible avec le système de drainage externe du LCR Hermetic™ Plus :


References Description

INS8700	<ul style="list-style-type: none"> • Poche de recueil de recharge de 700 mL • Anti-Reflux valve
	<ul style="list-style-type: none"> • Sans Latex • Sterile, 5 unités par boîte



*Liquide Céphalo-Rachidien

Système de Drainage Externe Monté sur Potence Hermetic™ - Système de Drainage du LCR*

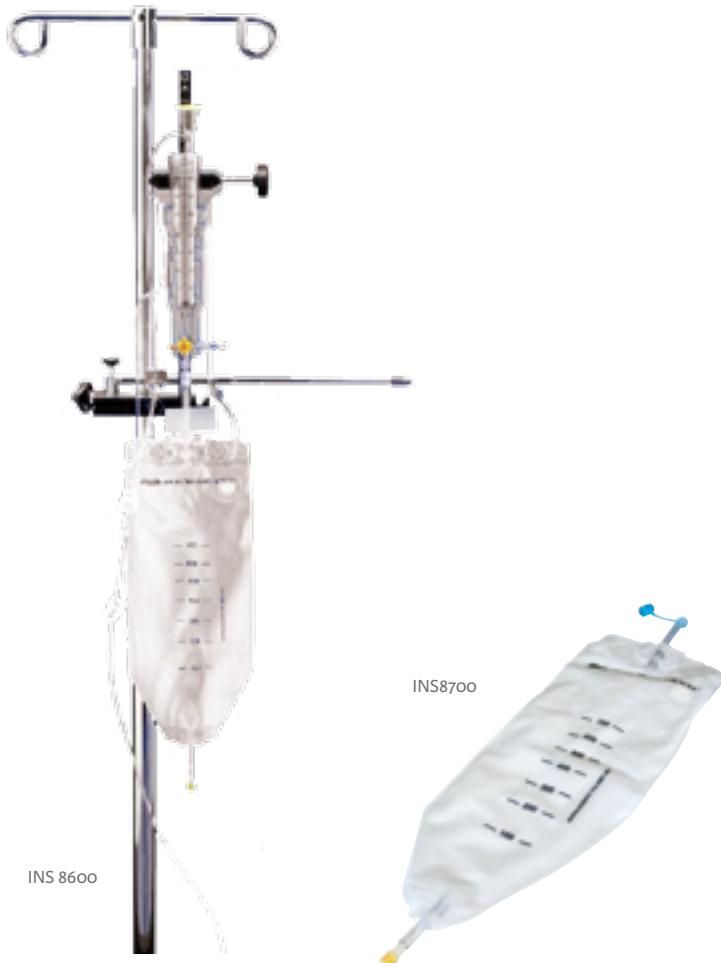

- 2 sites d'échantillonage sans aiguille SmartSite®
- Aération hydrophobe antimicrobienne
- Burette graduée de 50 mL
- Robinet de la ligne patient et de burette
- Poche de recueil de 700 mL
- valve anti-retour reliée distal du robinet patient.
- Produit non testé dans un environnement IRM

Références Description

INS8600	<ul style="list-style-type: none"> • Ligne de patient à tubulure bleue à grand diamètre d'ouverture • Un clapet anti-retour attaché du côté distal du robinet de la ligne patient
---------	---

INS8601	<ul style="list-style-type: none"> • Ligne de patient à tubulure de pression verte à rayures • Un clapet anti-retour amovible du côté distal du robinet du panneau de montage
---------	---

- Sans Latex
- Stérile, emballage individuel

Cathéters ventriculaire et lombaire compatible avec le système de drainage externe du LCR Hermetic™ :

Références Description

INS8220	Kit de cathéter ventriculaire Hermetic™
INS4000	Kit de cathéter ventriculaire Hermetic™, petite taille
INS4500	Kit de cathéter ventriculaire Hermetic™, grande taille
INS8420	Kit de cathéter ventriculaire TraumaCath™
INS5010	Kit de cathéter lombaire Hermetic™ à extrémité fermée

INS8330	Kit de cathéter lombaire Hermetic™ à extrémité ouverte
---------	--

- Sans Latex
- Stérile, emballage individuel

Poche de recueil compatible avec le système de drainage externe du LCR Hermetic™ :

References Description

INS8700	<ul style="list-style-type: none"> • Poche de recueil de recharge de 700 mL • Valve anti-retour
---------	---

- Sans Latex
- Stérile, 5 unités par boîte

Dispositif de Fixation sur Potence

- Rail gradué permettant de mesurer en cm de H2O et en mmHg
- Antenne télescopique

References Description

INS305	Compatible avec Hermetic™ Système de drainage externe du LCR INS8600 & INS8601
--------	--

- Sans Latex
- Emballage individuel

*Liquide Céphalo-Rachidien



Système de Drainage LCR Standard - Set de Drainage Externe (EDS)



EDS Standard	Contenu du kit	Références			
		EDS	EVDS*	LDS**	EVDS + ICP Monitoring
		910110A	910112A	910120A	910123A
	Unité(s) par boîte	6	1	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> Ligne patient 150 cm Robinet à 4 voies Valve anti-retour et site de prélèvement Burette cylindrique de 75 ml avec filtre de ventilation hydrophobe Ensemble Connecteurs en "T"/robinet Poche de recueil de 500 ml Réglette graduée de 350 mm H₂O Filtre hydrophobique. 	✓	✓	✓	✓
	<ul style="list-style-type: none"> Cathéter Ventriculaire droit (35 cm, 8 Fr) Guide d'introduction de 20 cm et 35 cm Collier de suture (8 Fr) Trocart Connecteur Luer Lock et capuchon étanche 	—	✓	—	✓
	<ul style="list-style-type: none"> Capteur de pression externe 	—	—	—	✓
	<ul style="list-style-type: none"> Cathéter lombaire à extrémité fermée (80 cm, 5 Fr) Collier de suture (5 Fr) Connecteur Luer lock Aiguille Tuohy de 14 G Guide avec gaine de protection 	—	—	✓	—
<ul style="list-style-type: none"> Sans Latex Stérile, emballage individuel 					

EDS Sans-Aiguille	Contenu du kit	Références	
		EVDS	LDS
		910112N	910120N
	Unité(s) par boîte	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> Ligne patient 150 cm Robinet à 4 voies Valve anti-retour et site de prélèvement Burette cylindrique de 75 ml avec filtre de ventilation hydrophobe Ensemble Connecteurs en "T"/robinet Poche de recueil de 500 ml Réglette graduée de 350 mm H₂O 	✓	✓
	<ul style="list-style-type: none"> Cathéter Ventriculaire droit(35 cm, 8 Fr) Guide d'introduction de 20 cm et 35 cm Collier de suture (8 Fr) Trocart Connecteur luer lock et capuchon étanche 	✓	—
	<ul style="list-style-type: none"> Cathéter lombaire à extrémité fermée (80 cm, 5 Fr) Collier de suture (5 Fr) Connecteur Luer lock Aiguille Tuohy de 14 G Guide avec gaine de protection 	—	✓
<ul style="list-style-type: none"> Sans Latex Stérile, emballage individuel 			

*Set de drainage externe ventriculaire


**Set de drainage lombaire

Système de Drainage LCR Standard - Set de Drainage Intégral (IDS)

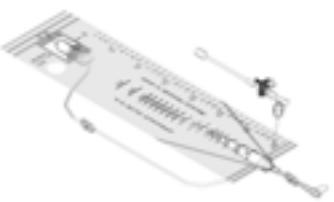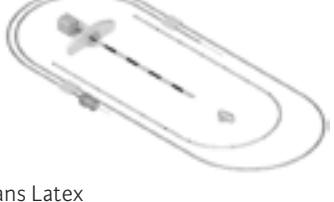IDS Standard	Contenu du kit	Références		
		IDS	IVDS***	ILDS****
	Unité(s) par boîte	910410	910412	910420
	 <p>Assemblage monobloc</p> <ul style="list-style-type: none"> Ligne patient comprenant un clamp, une valve anti-retour Sac gradué de 700 mL Filtre hydrophobe Compte-goutte Cordon de suspension avec butée réglable Robinet 3 voies avec 2 connecteurs Luer-lock femelle à capuchon Prolongateur de 10 cm avec connecteur Luer-lock mâle à capuchon 	6	1	1
	 <ul style="list-style-type: none"> Cathéter Ventriculaire droit (35 cm, 8 Fr) Guide d'introduction de 20 cm et 35 cm Collier de suture (8 Fr) Trocart 	-	✓	-
	 <ul style="list-style-type: none"> Cathéter lombaire à extrémité fermée (80 cm, 5 Fr) Collier de suture (5 Fr) Connecteur Luer lock Aiguille Tuohy de 14 G Guide avec gaine de protection 	-	-	✓

- Sans Latex
- Stérile, emballage individuel

Système de Drainage LCR Standard - Système de Drainage Ventriculaire

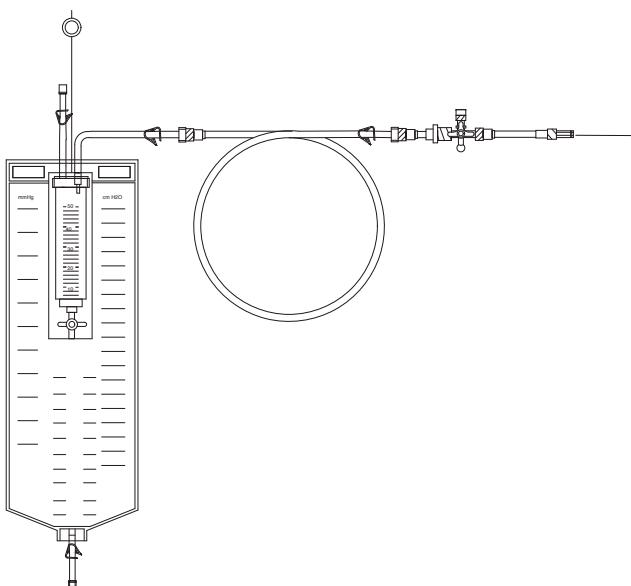

- Ligne patient avec clamp et orifice d'injection et de prélèvement auto-étanche
- Robinet à quatre voies
- Chambre compte-gouttes rigide de 50 mL avec robinet d'arrêt à une voie
- Echelle de graduation de 30 cmH2O et 20 mmHg
- Valve anti-retour amovible

Références

NL850500V

- Sans Latex
- Stérile, emballage individuel

***Set de drainage ventriculaire intégral

****Set de drainage lombaire intégral



Integra®
Cathéters
& Accessoires

Kit de Cathéter Ventriculaire Hermetic™

Références Description

INS8220	<ul style="list-style-type: none"> Un cathéter ventriculaire de 35 cm imprégné de barium avec diamètre externe : 2.7 mm x diamètre interne : 1.3 mm Un guide en acier inoxydable de 38 cm Un connecteur luer Un anneau de suture Un trocart 10 Fr. de 15 cm de long Un capuchon jaune à extrémité mâle
---------	--

- Sans Latex
- Stérile, emballage individuel

Compatible avec les Systèmes de Drainage Externe suivants :

Références Description

INS8400 INS8401	AccuDrain™ Système de drainage externe du LCR
INS8301	Hermetic™ Plus Système de drainage externe du LCR
INS8600 INS8601	Hermetic™ Système de drainage externe du LCR



Kit de Cathéter Ventriculaire Hermetic™, Petite Taille

Références Description


INS4000	<ul style="list-style-type: none"> Un cathéter ventriculaire de 20 cm comportant une bande de baryum avec diamètre externe : 2.5 mm x diamètre interne : 1.3 mm Un guide en acier inoxydable de 26 cm Un connecteur luer Un anneau de suture Un trocart 10 Fr. de 15 cm de long Un capuchon jaune à extrémité mâle
---------	--

- Sans Latex
- Stérile, emballage individuel

Compatible avec les Systèmes de Drainages Externe suivants :


Références Description

INS8400 INS8401	AccuDrain™ Système de drainage externe du LCR
INS8301	Hermetic™ Plus Système de drainage externe du LCR
INS8600 INS8601	Hermetic™ Système de drainage externe du LCR

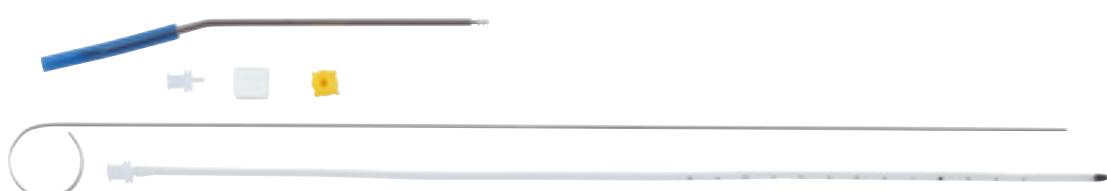


Kit de Cathéter Ventriculaire Hermetic™, Grande Taille

Références	Description	Compatible avec les Systèmes de Drainage Externe suivants :								
INS4500	<ul style="list-style-type: none"> Un cathéter ventriculaire de 35 cm comportant une bande de baryum avec diamètre externe : 3.0 mm x diamètre interne : 1.6 mm Un guide en acier inoxydable de 38 cm Un connecteur luer Un anneau de suture Un trocart 10 Fr. de 15 cm de long Un capuchon jaune à extrémité mâle 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Références</th><th>Description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INS8400 INS8401</td><td>AccuDRAIN™ Système de drainage externe du LCR</td></tr> <tr> <td>INS8301</td><td>Hermetic™ Plus Système de drainage externe du LCR</td></tr> <tr> <td>INS8600 INS8601</td><td>Hermetic™ Système de drainage externe du LCR</td></tr> </tbody> </table>	Références	Description	INS8400 INS8401	AccuDRAIN™ Système de drainage externe du LCR	INS8301	Hermetic™ Plus Système de drainage externe du LCR	INS8600 INS8601	Hermetic™ Système de drainage externe du LCR
Références	Description									
INS8400 INS8401	AccuDRAIN™ Système de drainage externe du LCR									
INS8301	Hermetic™ Plus Système de drainage externe du LCR									
INS8600 INS8601	Hermetic™ Système de drainage externe du LCR									
	<ul style="list-style-type: none"> Sans Latex Stérile, emballage individuel 									

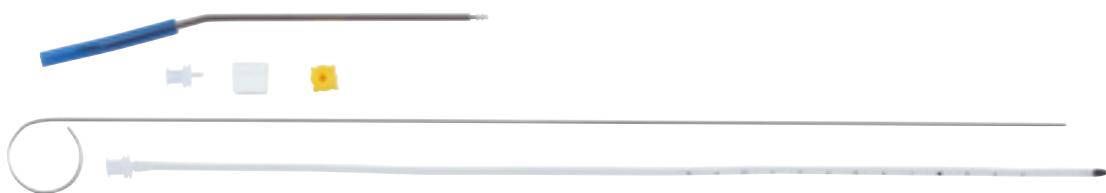


Kit de Cathéter Ventriculaire TraumaCath™

Références	Description	Compatible avec les Systèmes de Drainage Externe suivants :								
INS8420	<ul style="list-style-type: none"> Un cathéter ventriculaire de 35 cm comportant une bande de baryum avec diamètre externe : 3.3 mm x diamètre interne : 1.9 mm Un guide en acier inoxydable de 38 cm Un connecteur luer Un anneau de suture Un trocart 10 Fr. de 15 cm de long Un capuchon jaune à extrémité mâle Orifice de drainage large (1.8 mm de diamètre) 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Références</th><th>Description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INS8400 INS8401</td><td>AccuDRAIN™ Système de drainage externe du LCR</td></tr> <tr> <td>INS8301</td><td>Hermetic™ Plus Système de drainage externe du LCR</td></tr> <tr> <td>INS8600 INS8601</td><td>Hermetic™ Système de drainage externe du LCR</td></tr> </tbody> </table>	Références	Description	INS8400 INS8401	AccuDRAIN™ Système de drainage externe du LCR	INS8301	Hermetic™ Plus Système de drainage externe du LCR	INS8600 INS8601	Hermetic™ Système de drainage externe du LCR
Références	Description									
INS8400 INS8401	AccuDRAIN™ Système de drainage externe du LCR									
INS8301	Hermetic™ Plus Système de drainage externe du LCR									
INS8600 INS8601	Hermetic™ Système de drainage externe du LCR									
	<ul style="list-style-type: none"> Sans Latex 									

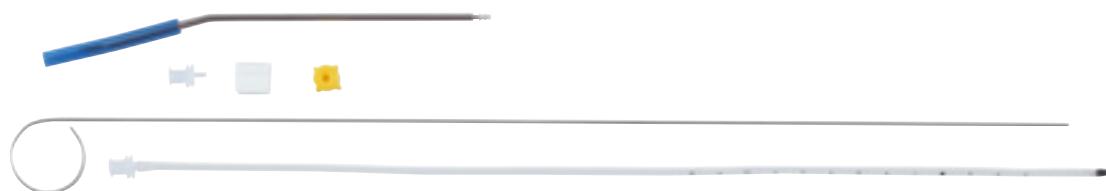

Kit de Cathéter Ventriculaire (VCAK)

Références	Description	Compatible avec les Systèmes de Drainage Externe suivants :
951303	<ul style="list-style-type: none"> Cathéter ventriculaire droit radiopaque de 35 cm, 8 Fr, avec des orifices proximaux de large diamètre et des points de repère à 5, 10, et 15 cm. Diamètre externe : 2.7 mm; diamètre interne : 1.4 mm Mandrin de 35 et 20 cm Connecteur Luer Lock et capuchon étanche Collier de suture (8 Fr) Trocart <ul style="list-style-type: none"> Sans Latex Stérile, emballage individuel 	Références Description 910110A Set de Drainage Externe (EDS) 910410 Set de Drainage Integral (IDS)

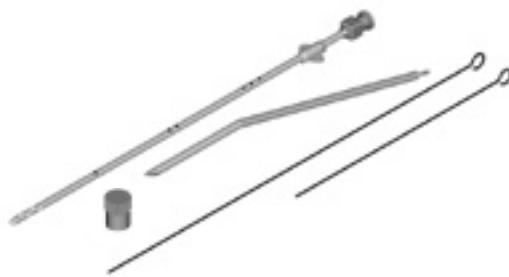

Cathéter Ventriculaire Droit de Drainage

Références	Description	Compatible avec les Systèmes de Drainage Externe suivants :
901302	<ul style="list-style-type: none"> Cathéter ventriculaire droit radiopaque de 20 cm, 8 Fr, avec des orifices proximaux de large diamètre et des points de repère à 5, 10, et 15 cm. Diamètre externe : 2.7 mm; diamètre interne : 1.4 mm Mandrin de 22 cm Connecteur Luer Lock et capuchon étanche Collier de suture (8 Fr) <ul style="list-style-type: none"> Sans Latex Stérile, emballage individuel 	Références Description 910110A Set de Drainage Externe (EDS) 910410 Set de Drainage Integral (IDS)



Kit de Cathéter Intraventriculaire de Monitorage (IVMCS)

Références	Description	Compatible avec les Systèmes de Drainage Externe suivants :
910130A	<ul style="list-style-type: none"> Cathéter ventriculaire droit radiopaque de 35 cm, 8 Fr, avec des orifices proximaux de large diamètre et des points de repère à 5, 10, et 15 cm. Diamètre externe : 2.7 mm; diamètre interne : 1.4 mm Mandrin de 35 et 20 cm Connecteur Luer Lock et capuchon étanche Collier de suture (8 Fr) Ensemble Connecteur en "T"/robinet avec robinet à 3 voies et un site d'accès autoocclusif <ul style="list-style-type: none"> Sans Latex Stérile, emballage individuel 	Références Description 910110A Set de Drainage Externe (EDS) 910410 Set de Drainage Integral (IDS)



Kit de Cathéter Lombaire Hermetic™ à Extrémité Fermée

Références Description


INS5010	<ul style="list-style-type: none"> Un cathéter lombaire de 80 cm à extrémité fermée diamètre externe : 1.5 mm x diamètre interne : 0.7 mm Une aiguille Tuohy de calibre 14 gauge x 8.8 cm Un adaptateur luer flexible Deux anneaux de suture Un pansement Veni-Guard® Un tubulure de réduction de tension Un guide revêtu de PTFE Une aiguille mousse de calibre 22 Un capuchon jaune à extrémité mâle
---------	---

- Sans Latex
- Stérile, emballage individuel

Compatible avec les Systèmes de Drainage Externe suivants :

Références Description

INS8400 INS8401	AccuDRAIN™ Système de drainage externe du LCR
INS8301	Hermetic™ Plus Système de drainage externe du LCR
INS8600 INS8601	Hermetic™ Système de drainage externe du LCR

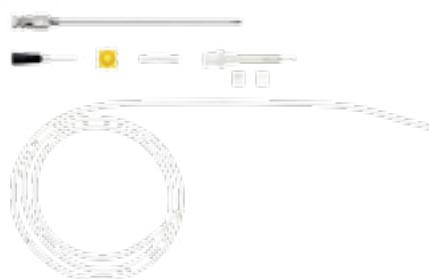

Kit de Cathéter Lombaire Hermetic™ à Extrémité Ouverte

Références Description


INS8330	<ul style="list-style-type: none"> Un cathéter lombaire de 80 cm à extrémité ouverte diamètre externe : 1.5 mm x diamètre interne : 0.7 mm Une aiguille Tuohy de calibre 14 gauge x 8.8 cm Un adaptateur luer flexible Deux anneaux de suture Un pansement Veni-Guard® Un tubulure de réduction de tension Un guide revêtu de PTFE Une aiguille mousse de calibre 22G Un capuchon jaune à extrémité mâle
---------	---

- Sans Latex
- Stérile, emballage individuel

Compatible avec les Systèmes de Drainage Externe suivants :

Références Description

INS8400 INS8401	AccuDRAIN™ Système de drainage externe du LCR
INS8301	Hermetic™ Plus Système de drainage externe du LCR
INS8600 INS8601	Hermetic™ Système de drainage externe du LCR

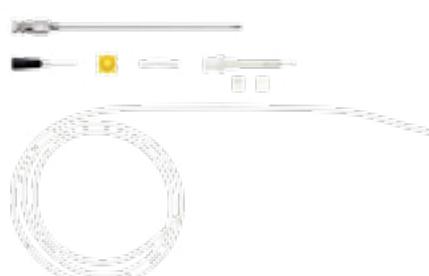

Kit de Cathéter Lombaire (LCAK)

Références Description

910121	<ul style="list-style-type: none"> Cathéter radiopaque elastomère avec extrémité distale fermée et points de repère tout les 2 cm (80 cm, 5 Fr) Diamètre externe : 1.6 mm; diamètre interne : 0.8 mm Collier de suture (5 Fr) Connecteur Luer Lock Aiguille de Tuohy 14G Guide avec gaine de protection
--------	---

- Sans Latex
- Stérile, emballage individuel

Compatible avec les Systèmes de Drainages Externe suivants :

Références Description

910110A	Set de Drainage Externe (EDS)
910410	Set de Drainage Integral (IDS)




Poche de Recueil de Rechange

Références	Description	Compatible avec les Systèmes de Drainage Externe suivants :
INS8700	<ul style="list-style-type: none"> Poche de recueil de recharge de 700 mL Valve anti-retour 	
	<ul style="list-style-type: none"> Sans Latex Stérile, 5 unités par boîte 	
Références	Description	
INS8400 INS8401	AccuDRAIN™ Système de drainage externe du LCR	
INS8301	Hermetic™ Plus Système de drainage externe du LCR	
INS8600 INS8601	Hermetic™ Système de drainage externe du LCR	




Poche de Recueil de Rechange

Références	Description	Compatible avec les Systèmes de Drainage Externe suivants :
910116A	<ul style="list-style-type: none"> Poche de receuil de 500 mL fermée 	
910116D	<ul style="list-style-type: none"> Poche de receuil de 500 mL vidangeable 	
	<ul style="list-style-type: none"> Stérile, 6 unités par boîte 	
Références	Description	
910110A 910112A/N 910120A/N 910123A	Set de Drainage Externe - EDS	

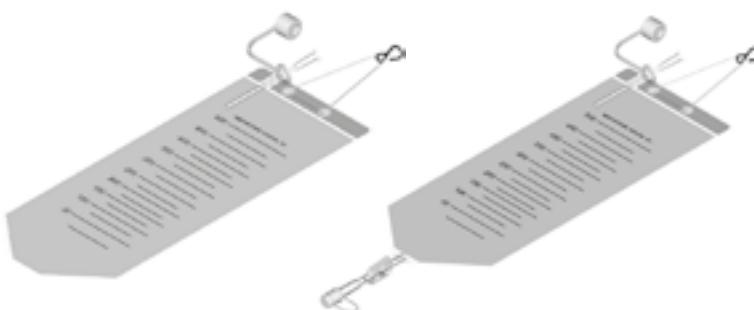

Kit Accessoire de Drainage

Références	Description
910122	<ul style="list-style-type: none"> Poche de recueil de 500 mL fermée avec ligne de patient de 150 cm pour drainage per-opératoire du LCR
	<ul style="list-style-type: none"> Stérile, 5 unités par boîte

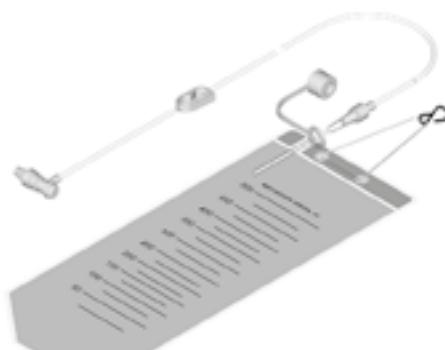



Connecteur Luer Lock

- Connecteur Luer Lock en polycarbonate
- Diamètre externe : 2.0 mm; diamètre interne : 1.4 mm pour cathéter de 8 Fr


Références	Description
910128	Non-stérile, 36 unités par boîte
999108	Stérile, 5 unités par boîte



Connecteur Luer Lock


- Connecteur Luer Lock en polycarbonate
- Diamètre externe : 1.2 mm; diamètre interne : 0.7 mm pour cathéter de 5 Fr et 7 Fr

Références	Description
999105	Stérile, 5 unités par boîte



Collier de Suture

Références	Description
999005	Silicone radiopaque élastomère, pour une utilisation avec des cathéters de 5 Fr.
999007	Silicone radiopaque élastomère, pour une utilisation avec des cathéters de 8 Fr.
• Stérile, 5 unités par boîte	

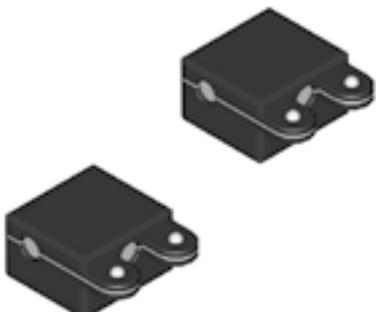

Boîtier de Protection de Robinet

Références	Description
910400	Boîtier de protection de robinet

Compatible avec les Systèmes de Drainage Externe suivants :

Référence	Description
910410	Système de Drainage Intégral - IDS



Integra®
Accès Crânien


Kit d'Accès Crânen

Références

INS5HND

Légendes	Description
1	Rasoir jetable
2	Seringues de sécurité de 12 cc (2)
3	Aiguilles de calibre 18 G x 1-1/2" (2)
4	Aiguille de calibre 25 G x 5/8"
5	Aiguille médullaire de calibre 18 G x 3-1/2"
6	Aiguille ventriculaire de calibre 12 G x 5-1/2"
7	Champ fenêtré de 15" x 15" avec barrière
8	Pansements absorbants blancs de 18" x 26" (3)
9	Compresses de gaze de 4" x 4" (10)
10	Perceuse à main
11	Lame de bistouri n° 11 avec manche
12	Lame de bistouri n° 15 avec manche
13	Pince d'Adson, à dent de scie
14	Pince d'Adson, 1 x 2 dents
15	Porte-aiguille
16	Cupule de 2 oz (60 ml) (2)
17	Ecarteur auto-bloquant
18	Paire de ciseaux
19	Trépan de 5,31 mm
20	Suture en nylon 3-0 (emballée à l'extérieur du kit)
21	Marqueur
22	Règle flexible
23	Clé hexagonale

- Stérile, emballage individuel ou par 5

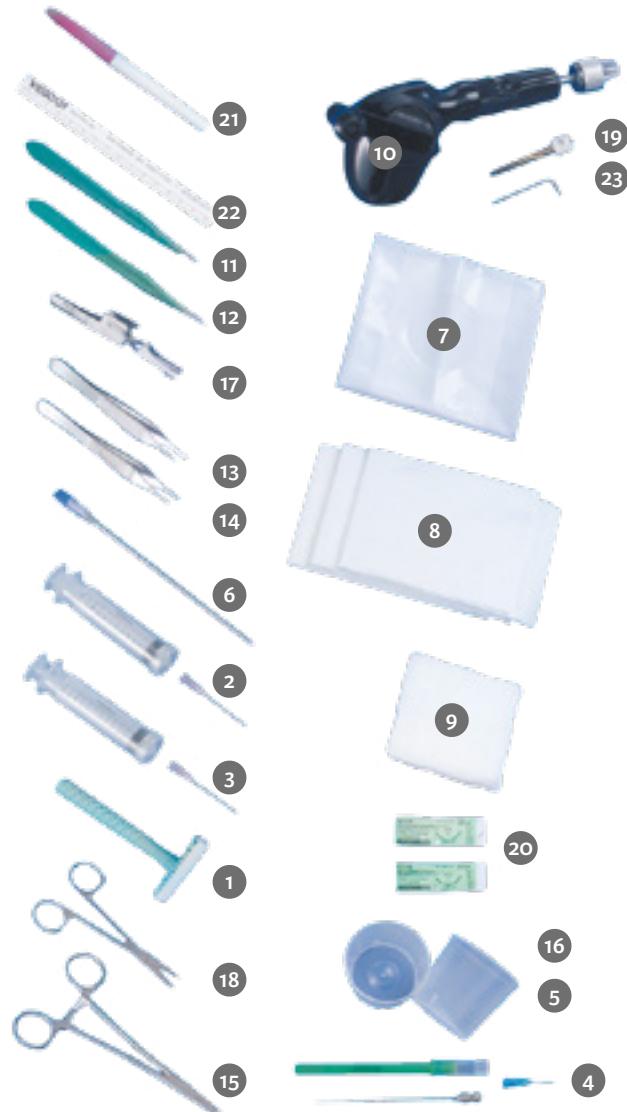

Perceuse à Main



Références Description

INS030	Perceuse à main (trépan non inclus) à usage unique destinée aux procédures neurochirurgicales
--------	---

- Sans Latex
- Stérile, emballage individuel

Trépans



Références Description

SPo075	Trépan stérile à usage unique avec bague de sécurité, 3,97 mm (5/32")
SPo087	Trépan stérile à usage unique avec bague de sécurité, 5,31 mm (13/64")
SPo088	Trépan stérile à usage unique avec bague de sécurité, 6,35 mm (1/4")

- Sans Latex
- Emballage individuel

SPo075

SPo087


SPo088



Integra®
Autres Produits
de Drainage

Cathéter Sous-Dural de Mesure de la Pression Intracrânienne

- Cathéter en élastomère de silicone imprégné de sulfate de baryum
- Peut être relié à un système externe d'enregistrement/ capteur de pression physiologique
- Connecteur Luer Lock
- Cathéter diamètre interne: 1.02 mm, diamètre externe: 3.1 mm

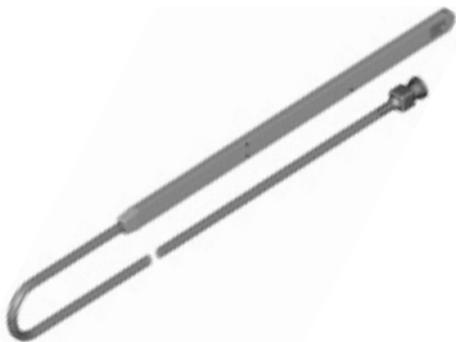

Références Description

910125	Cathéter standard de 100 cm avec indicateur à 10 et 20 cm de l'extrémité
--------	---

- Sans Latex
- Stérile, emballage individuel

Cathéter Sous-Dural & Kit

- Cathéter de drainage radiopaque en élastomère de silicone avec une tubulure F8 avec une cage creuse et plate à son extrémité distale (20 cm, 8 Fr).
- Diamètre externe : 2.7 mm; diamètre interne : 1.2 mm
- Stylet d'introduction
- Guide à angle droit
- Connecteur Luer Lock
- Collier de suture papillon (8 Fr)



Références Description

951315	Cathéter sous-dural
951310 (avec en addition les composants du kit)	Kit cathéter sous-dural prêt à l'emploi: <ul style="list-style-type: none"> • cathéter sous-dural • trépan de 5 mm avec anneau d'ajustement et à usage unique • clé d'alène • tunnéliseur sous-cutané

- Sans Latex
- Stérile, emballage individuel


Poire de Drainage

- Poire, capacité 100 cc avec graduations tous les 25 cc
- Tubulure d'extention
- Connecteur Luer Lock

Références

910500

- Stérile, emballage individuel

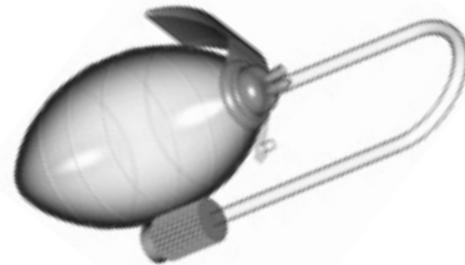**Cathéter de Ponction de Kystes**

- Cathéter de ponction avec graduations radio opaques à 5, 10 et 15 cm de l'extrémité.
- Cathéter radio opaque en élastomère de silicone, de 25 cm de longueur, avec un embout distal effilé et percé de deux larges orifices latéraux, diamètre externe : 2.7 mm; diamètre interne 1.4 mm
- Un stylet à embout arrondi pour le placement du cathéter
- un stylet à embout pointu pour ponctionner le kyste

**Références**

951401

- Sans Latex
- Stérile, emballage individuel



Integra®
Indications
Contre-indications

AccuDrain™ Système de drainage externe du LCR

Ref INS8400/8401

Indications

Le drainage et la surveillance du flux de liquide céphalorachidien (LCR) sortant des ventricules latéraux du cerveau ou de l'espace lombaire sous-arachnoïdien est indiqué chez des patients sélectionnés pour :

- Réduire la pression intracrânienne (PIC)
- Surveiller la pression intracrânienne (PIC)
- Surveiller le liquide céphalorachidien (LCR)
- Assurer le drainage temporaire du LCR

Contre-indications

Ce dispositif n'est pas conçu, vendu ou prévu pour être utilisé d'une manière autre que celle qui est indiquée. Le système de drainage externe est contre-indiqué dans les circonstances suivantes : traitement anticoagulant, troubles de la coagulation, infections non traitées du cuir chevelu. L'emploi du système est contre-indiqué lorsque aucun membre du personnel ayant la formation requise n'est disponible pour surveiller le drainage et assurer la surveillance 24 heures sur 24.

Hermetic™ & Hermetic™ Plus système de drainage externe du LCR

Ref INS8301/INS8600/INS8601

Indications

Le drainage et la surveillance du flux de liquide céphalorachidien (LCR) sortant des ventricules latéraux du cerveau ou de l'espace lombaire sous-arachnoïdien sont indiqués chez certains patients pour :

- Réduire la pression intracrânienne (PIC)
- Surveiller la pression intracrânienne (PIC)
- Surveiller le liquide céphalorachidien (LCR)
- Assurer le drainage temporaire du LCR chez les patients pourvus de dérivation hydrocéphalique infectée

La surveillance de la pression intracrânienne (PIC) est normalement effectuée chez certains patients présentant les conditions suivantes :

- Blessure grave de la tête
- Hémorragie sous-arachnoïdienne
- Syndrome de Reyes ou encéphalopathies semblables
- Hydrocéphalie
- Hémorragie intracrânienne
- Sous la supervision et à la discréction du médecin lorsqu'on utilise le drainage comme un geste thérapeutique

La surveillance peut également être utilisée pour évaluer l'état pré- et post-opératoire des lésions et de l'espace qu'elles occupent.

Contre-indications

Le dispositif n'est pas conçu, vendu ou prévu pour être utilisé d'une manière autre que celle qui est indiquée.

La surveillance du drainage lombaire et/ou de la pression lombaire ne doit pas être utilisée en présence des conditions suivantes : hydrocéphalie non communicante, grande masse ou tumeur, ou grand hématome intracrânien, et chez les patients ayant manifesté une occlusion des voies du liquide céphalorachidien résultant d'un traumatisme, d'une tumeur, d'un hématome ou de toute autre grande masse intracrânienne.

Les cathétères lombaires sont contre-indiqués dans les cas d'anomalies spinales qui empêcheraient la libre insertion du cathéter lombaire. Les cathétères lombaires sont contre-indiqués chez les nourrissons dont la partie inférieure de la moelle épinière n'a pas encore migré en direction céphalique jusqu'à la position L1-2. Compte tenu du rétrécissement notoire du canal lombo-sacré chez les patients achondroplasiques, un cathéter lombaire dans l'espace sous-arachnoïdien est contre-indiqué.

Système de drainage ventriculaire

Ref NL850500V

Indications

La principale indication d'utilisation d'un drainage externe est la gestion d'infections par dérivation hydrocéphalique. Si une dérivation interne n'est pas indiquée, le traitement d'autres états cérébraux tels qu'un drainage préopératoire, une hémorragie intraventriculaire et un monitorage postopératoire de la pression peut également nécessiter le drainage externe de L.C.R. pour réguler la hausse de pression intracrânienne.

Contre-indications

Ce dispositif n'a pas été conçu pour être utilisé à d'autres fins que celles indiquées ici.

Kit de cathéter ventriculaire Hermetic™ et TraumaCath™

Ref INS8220/INS4000/INS4500/INS8420/INS5010 & INS8330

Indications

Les cathétères de drainage ventriculaire externe sont indiqués pour le drainage et le monitorage du liquide céphalorachidien (LCR) des ventricules latéraux du cerveau. Ils peuvent être utilisés pour réduire la pression intracrânienne (PIC), pour le monitorage de la PIC, le monitorage du LCR et le traitement des infections de dérivation chirurgicales du LCR dans l'hydrocéphalie. Les cathétères de drainage lombaire externe sont indiqués pour le drainage et le monitorage du LCR de l'espace sous-arachnoïdien.

Contre-indications

Ces dispositifs ne sont pas conçus, vendus ou destinés à d'autres usages que ceux indiqués ci-dessus.

Un drainage lombaire et/ou un monitorage de la pression lombaire ne doivent pas être entrepris en présence d'une hydrocéphalie non communicante ; d'une masse intracrânienne importante, d'une tumeur ou d'un hématome ; ou sur des patients présentant un blocage des voies du liquide céphalo-rachidien à la suite d'un traumatisme, d'une tumeur, d'un hématome ou d'une autre masse intracrânienne importante. Les cathétères lombaires sont contre-indiqués dans les cas d'anomalies rachidiennes susceptibles d'empêcher la libre introduction d'un cathéter lombaire. Les cathétères lombaires sont contre-indiqués chez les nouveau-nés dont l'extrémité inférieure de la moelle épinière n'a pas encore migré dans sa position L1-2 en direction céphalique. En raison de la sténose marquée du canal lombo-sacré chez les patients atteints d'achondroplasie, il est contre indiqué d'implanter un cathéter lombaire dans l'espace sous-arachnoïdien de ces patients.

Kit de cathéter ventriculaire (VCAK)

Ref 951303/901302

Indications

L'ensemble de cathéter ventriculaire est conçu pour être utilisé avec un système Integra de drainage externe, prélèvement et collection du liquide céphalorachidien (LCR).

Contre-Indications

L'utilisation du cathéter de drainage externe est déconseillée chez certains patients :

- Atteints d'anomalies de la coagulation sanguine,

- Sous traitement anticoagulant,
- Présentant une infection de la peau ou du cuir chevelu.

Ensemble de cathéter pour le contrôle de la pression intraventriculaire (IVMCS)

Ref 910130A

Indications

L'ensemble de cathéter est indiqué pour le drainage externe du liquide céphalorachidien et permet le prélèvement, le contrôle du LCR et le monitoring de la pression intracrânienne.

Contre-indications

Le monitoring de la pression intracrânienne et le drainage externe du LCR sont contre-indiqués chez les patients atteints d'anomalies de la coagulation sanguine, sous traitement anti-coagulant ou présentant une infection de la peau ou du cuir chevelu.

Set de drainage externe (EDS)

Ref 910110A/910112A/910120A/910123A/910112N/910120N

Indications

Les systèmes de drainage sont indiqués pour le drainage, le prélèvement et le recueil du liquide céphalo-rachidien (LCR).

Contre-indications

Le drainage ventriculaire externe est contre-indiqué chez les patients atteints d'anomalies de la coagulation sanguine, sous traitement anticoagulant ou présentant une infection de la peau ou du cuir chevelu.

Kit de cathéter intraventriculaire de monitorage (IVMCS)

Ref 910130A

Indications

L'ensemble de cathéter est indiqué pour le drainage externe du liquide céphalorachidien et permet le prélèvement, le contrôle du LCR et le monitoring de la pression intracrânienne.

Contre-indications

Le monitoring de la pression intracrânienne et le drainage externe du LCR sont contre-indiqués chez les patients atteints d'anomalies de la coagulation sanguine, sous traitement anti-coagulant ou présentant une infection de la peau ou du cuir chevelu.

Catheter sous-dural & Kit

Ref 951315/951310

Indications

Le Cathéter de Drainage Sous-Dural est indiqué pour le drainage de collections extra-ventriculaires tel que les hygromas et les hématomes chroniques, avec un système de drainage externe (comme la poire de drainage ou les systèmes EDS ou IDS de Integra NeuroSciences) ou avec un cathéter implanté communiquant avec un site de drainage approprié. Le cathéter de drainage Sous-Dural est connecté à un système de drainage externe ou interne, selon l'état clinique du patient.

Contre-indications

L'utilisation du Cathéter Sous-Dural est contre-indiquée chez les patients présentant des hématomes sous-duraux aigus ou subaigus et chez les patients sous traitement anticoagulant.

Cathéter sous-dural de mesure de la pression intracrânienne

Ref 910125

Indications

Le Cathéter Sous-Dural de mesure de la pression intracrânienne est utilisé pour le contrôle continu de la pression intracrânienne.

Contre-indications

Aucune connue.

Catheter de ponction de kystes

Ref 951401

Indication

Le cathéter de ponction de kystes est utilisé pour la ponction et l'évacuation des kystes intracrâniens. Il est spécialement destiné à faciliter la ponction de lésions cystiques qui ne peuvent être pénétrées par des cathéters ventriculaires standards, soit parce que ces kystes ont des parois trop épaisses pour être pénétrées par des cathéters à embout non tranchant, soit parce qu'ils sont relativement mobiles et sont alors plutôt déplacés par le cathéter que ponctionnés. Le cathéter de ponction de kystes sera connecté à un système de drainage interne (dérivation cysto-péritonéale) ou externe, selon l'état du patient.

Contre-indications

Aucune connue.

Kit de cathéter lombaire (LCAK)

Ref 910121

Indications

Le kit de cathéter lombaire permet de drainer le LCR à partir de l'espace intrathécal lombaire.

Contre-indications

Le drainage lombaire externe n'est pas conseillé chez les patients :

- Atteints d'anomalies de la coagulation sanguine qui sont sous traitement anticoagulant
- Avec des infections cutanées

Poire de drainage

Ref 910500

Indications

La Poire est destinée à être utilisée avec l'Ensemble de Drainage Sous-Dural pour le drainage de collections de liquide extra-ventriculaire.

Contre-indications

Aucune connue.



Index

Références

901302.....	16
910110A.....	10, 16, 17, 18
910112A.....	10, 18
910112N.....	10
910116A.....	18
910116D.....	18
910120A.....	10
910120A/N.....	18
910120N.....	10
910121.....	17
910122.....	18
910123A.....	10, 18
910125.....	26
910128.....	19
910130A.....	16
910400.....	19
910410.....	11, 16, 17
910412.....	11
910420.....	11
910500.....	26
951303.....	16
951310.....	26
951315.....	26
951401.....	26
999005.....	19
999007.....	19
999105.....	19
999108.....	19
INS5HND.....	22
INS030.....	23
INS305.....	9
INS4000.....	7, 8, 9, 14
INS4500.....	7, 8, 9, 15
INS5010.....	7, 8, 9, 17
INS8220.....	7, 8, 9, 14
INS8301.....	8, 14, 15, 17, 18
INS8330.....	7, 8, 9, 17
INS8400.....	6, 14, 15, 17, 18
INS8401.....	6, 14, 15, 17, 18
INS8420.....	7, 8, 9, 15
INS8600.....	9, 14, 15, 17, 18
INS8601.....	9, 14, 15, 17, 18
INS8700.....	7, 8, 9, 18
NL850500V.....	11
SP0075.....	23
SP0087.....	23
SP088.....	23

Références

A

AccuDrain™ Système de Drainage Externe du LCR	6
---	---

B

Boîtier de Protection de Robinet	19
--	----

C

Cathéter de Ponction de Kystes	26
Cathéter Sous-Dural de Mesure de la Pression Intracrânienne	26
Cathéter Sous-Dural & Kit	26
Cathéter Ventriculaire Droit de Drainage	16
Collier de Suture	19
Connecteur Luer Lock	19

D

Dispositif de fixation sur potence	9
--	---

H

Hermetic™ Plus Système de drainage externe du LCR	8
---	---

K

Kit Accessoire de Drainage	18
Kit d'Accès Crânien	22
Kit de Cathéter Intraventriculaire de Monitorage (IVMCS)	16
Kit de Cathéter Lombaire Hermetic™ à Extrémité Fermée	7, 8, 9, 17
Kit de Cathéter Lombaire Hermetic™ à Extrémité Ouverte	7, 8, 9, 17
Kit de Cathéter Lombaire (LCAK)	17
Kit de cathéter ventriculaire Hermetic™, Grande Taille	7, 8, 9, 15
Kit de cathéter ventriculaire Hermetic™, Petite Taille	7, 8, 9, 14
Kit de cathéter ventriculaire TraumaCath™	7, 8, 9, 15
Kit de Cathéter Ventriculaire (VCAK)	16

P

Perceuse à Main	23
Poche de recueil compatible avec le système de drainage externe du LCR Hermetic™	9
Poche de recueil compatible avec le système de drainage externe du LCR Hermetic™ Plus	8
Poche de Recueil de Recharge	18
Poche de recueil de recharge de 700 mL	7
Poire de Drainage	26

S

Système de Drainage Externe Monté sur Panneau	6, 7
Système de Drainage LCR Standard - Set de Drainage Externe (EDS)	10
Système de Drainage LCR Standard - Set de Drainage Integral (IDS)	11
Système de Drainage LCR Standard - Système de Drainage Ventriculaire	11

T

Trépans	23
---------------	----



Distribué par

 Integra Pain Management
3498 West 2400 South Suite 1050 ■ West Valley City
Utah 84119 ■ USA

 Integra NeuroSciences Implants (France) S.A.S.
2905 route des dolines
06921 Sophia Antipolis Cedex ■ FRANCE

Integra LifeSciences Services (France) SAS
Ventes & Marketing EMEA
Immeuble Séquoia 2 ■ 97 allée A. Borodine
Parc technologique de la Porte des Alpes
69800 Saint Priest ■ FRANCE
Tel : +33 (0)4 37 47 59 00 ■ Fax : +33 (0)4 37 47 59 99
emea.info@integralife.com ■ integralife.eu

 Integra LifeSciences Services (France) SAS
Integra LifeSciences Services (France) SAS
Immeuble Séquoia 2 ■ 97 allée Alexandre Borodine
Parc Technologique de la Porte des Alpes
69800 Saint Priest ■ FRANCE

Services Clients
International : +33 (0)4 37 47 59 50 ■ +33 (0)4 37 47 59 25 (Fax) ■ csemea@integralife.com
France : +33 (0)4 37 47 59 10 ■ +33 (0)4 37 47 59 29 (Fax) ■ custsvfrance@integralife.com
Belgique : +32 (0)2 257 4130 ■ +32 (0)2 253 2466 (Fax) ■ custsvbenelux@integralife.com
Allemagne : +49 (0) 2102 5535 6200 ■ +49 (0) 102 5536 636 (Fax) ■ custsvgermany@integralife.com
Suisse : +41 (0)2 27 21 23 30 ■ +41 (0)2 27 21 23 99 (Fax) ■ custsvsuisse@integralife.com
Royaume-Uni : +44 (0)1 264 345 780 ■ +44 (0)1 264 363 782 (Fax) ■ custsvuk@integralife.com

©2016 Integra LifeSciences Corporation. Tous droits réservés. Date de dernière révision : 05/16
Produits en vente uniquement en Europe, Moyen Orient et Afrique 0094381-2-FR



INTEGRA
LIMIT UNCERTAINTY

La disponibilité de ces produits peut varier d'un pays ou d'une région à l'autre du fait de procédures d'enregistrement réglementaires ou de conditions de vente locales spécifiques. Document non contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer sans préavis toute modification visant à améliorer la qualité de ses produits. Toutes les références mentionnées dans ce document sont marquées CE en accord avec la directive du conseil Européen 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux et ses amendements, sauf ceux spécifiquement identifiés comme "NON MARQUES CE". AVERTISSEMENT : La réglementation applicable peut réserver la vente de ces produits aux médecins ou sur ordonnance médicale. AccuDrain, Squeeze-Lok, Hermetic et TraumaCath sont des marques d'Integra LifeSciences Corporation. Integra et le logo Integra sont des marques enregistrées propriété de Integra LifeSciences Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Smartsite, Velcro et Veni-Guard sont des marques de leur propriétaires respectifs. Plusieurs produits mentionnés dans ce document sont des dispositifs de Classe I et III. Veuillez contacter les Services Clients Integra pour toute information complémentaire sur la classe des dispositifs. Lire attentivement les instructions d'utilisation.